

ACTA DE LA SESIÓN 2 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE 23/S/23/SU/CO/A/R03 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. Expediente cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027.

Fecha y hora de celebración

22 de septiembre de 2023 a las 08:30:00

Lugar de celebración

Sede Consejería de Sanidad, Avda. Juan XXIII, sala de reuniones.

Asistentes

PRESIDENTE

D. Yeray J. Talavera Martín, Técnico Titulado Superior

SECRETARIA

Dña. Elvira Carmen González Valido, Jefa de Sección de Gestión Económica

VOCALES

D. Raúl Lorenzo Pérez, Técnico Titulado Superior

D. Francisco José Sánchez Román, Interventor Delegado

Dña. Ana Isabel Lorenzo Álvarez, Letrada habilitada por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias

Orden del día

1.- Aprobación Informes Técnicos Lotes nº 1, nº 2 y nº 3

2.- Aprobación informe de valoración final

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente

4.- Propuesta adjudicación

5.- Aprobación del acta de la sesión

Se Expone

1.- Aprobación Informes Técnicos Lotes nº 1, nº 2 y nº 3

La Mesa acuerda por unanimidad la aprobación de los informes relativos al cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y a la valoración de los criterios de adjudicación técnicos de los lotes nº 1, nº 2 y nº 3 de la licitación, suscritos por los técnicos asignados para su valoración el 18 de septiembre de 2023.

Se adjuntan los informes técnicos relativos a los lotes n.º 1, n.º 2 y n.º 3 como **Anexo I**.

2.- Aprobación informe de valoración final

La Mesa acuerda por unanimidad la aprobación del informe final de valoración, en el que se detalla la valoración de los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes de los lotes n.º 1, n.º 2 y n.º 3 de la licitación, suscrito por el Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud el 20 de septiembre de 2023.

Se adjunta el informe de valoración final como **Anexo II**.

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente

Una vez remitida la información por los técnicos, la Mesa ha valorado las proposiciones técnicas de las empresas licitadoras de acuerdo a los criterios del PCAP, tal y como se relaciona en el informe final de valoración de 20 de septiembre de 2023 que figura como Anexo II.


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ELVIRA CARMEN GONZALEZ VALIDO - JEFE DE SECCION DE GESTION ECONOMICA
YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO

Fecha: 25/09/2023 - 08:36:28
Fecha: 22/09/2023 - 10:38:32

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0U7oBWGcx-vxsw9SReqizqKixr4xeOgX9



El presente documento ha sido descargado el 25/09/2023 - 08:36:43

4. Propuesta de adjudicación

De acuerdo con la evaluación de las propuestas de los licitadores, la Mesa concluye la propuesta de adjudicación que se indica a continuación, la cual propone elevar al Órgano de Contratación.

LOTE	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN CRITERIO 1. OFERTA EC.	PUNTUACIÓN CRITERIO 2. PRESTACIONES	TOTAL PUNTUACIÓN CRITERIOS
LOTE N.º 1	CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 1	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.	35,00	54,00	89,00
LOTE N.º 2	CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 2	DESIERTO	-----	-----	-----
LOTE N.º 3	CAMILLAS	LINET IBERIA, S.L.	35,00	53,00	88,00

5. Aprobación del acta de la sesión

La Mesa acuerda la aprobación de la presente sesión.

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente:

D^a. Elvira Carmen González Valido
SECRETARIA

D^a. Yeray J. Talavera Martín
PRESIDENTE

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ELVIRA CARMEN GONZALEZ VALIDO - JEFE DE SECCION DE GESTION ECONOMICA
YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO

Fecha: 25/09/2023 - 08:36:28
Fecha: 22/09/2023 - 10:38:32

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:



0U7oBWGcx-vxsw9SReqizqKixr4xeOgX9



El presente documento ha sido descargado el 25/09/2023 - 08:36:43

ANEXO I

INFORMES TÉCNICOS

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ELVIRA CARMEN GONZALEZ VALIDO - JEFE DE SECCION DE GESTION ECONOMICA YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO	Fecha: 25/09/2023 - 08:36:28 Fecha: 22/09/2023 - 10:38:32
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0U7oBWGcx-vxsw9SReqizqKixr4xeOgX9	 
El presente documento ha sido descargado el 25/09/2023 - 08:36:43	



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS ECONÓMICOS



Cofinanciado por la Unión Europea

EXPEDIENTE:

23/S/23/SU/CO/A/R03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. EXPEDIENTE COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 85% PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2021-2027.

LOTE I

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

TABLA DE CONTENIDO

1. EMPRESAS OFERTANTES / OFERTAS	- 3 -
1.1 Los documentos estudiados correspondientes a cada oferta son los siguientes:.....	- 3 -
2. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES GENERALES Y DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS (apartado 15.2.2. del PCAP)	- 4 -
2.1 Oferta Técnica:	- 4 -
2.2. Criterios de adjudicación	- 5 -
2.3. Compromiso de entrega:.....	- 5 -
2.4 Compromiso de fabricación:.....	- 5 -
2.5. Compromiso mantenimiento elementos ofertados y repuestos	- 6 -
2.6. Condiciones de la garantía	- 6 -
2.7. Información sobre accesorios y fungibles	- 6 -
2.8. Cumplimiento de la normativa	- 7 -
2.9 Formación.....	- 7 -
2.10. Condición especial de ejecución.....	- 7 -
2.11. Subcontratación:	- 7 -
3. EVALUACIÓN TÉCNICA	- 8 -
3.1. ACJ, SAU	- 8 -
3.2. DISPROSERCA, SL.....	- 9 -
3.3. INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, SL	- 10 -
3.4. LINET IBERIA, SL	- 11 -
3.5. MEDICAL IBERIA, SA	- 12 -
3.6. TÉCNICAS BIOFÍSICAS, SL.....	- 13 -
4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES.....	- 14 -
5. CONCLUSIONES	- 15 -


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

1. EMPRESAS OFERTANTES / OFERTAS

Se han analizado las siguientes ofertas y equipos correspondientes al Lote I:

OFERTA	EQUIPO OFERTADO	MUESTRAS	IMAGEN
ACJ, S.A.U.	MARCA: NITROCARE MODELO: NITRO HB 8140	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
DISPROSERCA, S.L.	MARCA: SCHRÖDER MODELO: CURA 4040	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	MARCA: PARDO MODELO: ADVANTCARE	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
LINET IBERIA, S.L.	MARCA: LINET MODELO: ESSENZA 300	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
MEDICAL IBÉRICA, S.A.	MARCA: MEDISA MODELO: GALAXY 3	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.	MARCA: HILL-ROM MODELO: HR900	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	

1.1 Los documentos estudiados correspondientes a cada oferta son los siguientes:

Tabla 1. Documentación presentada (94 documentos correspondientes a seis ofertas):

N.º	ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
1	Acreditación fabricante distribución - post-venta.pdf	Anexo Accesorios Fdo.pdf	0. Anexo_I_Oferta_economica.pdf	Declaración fungibles y accesorios.pdf	OFERTA TECNICA MEDICAL IBERICA. Lote 1.Lote2.pdf	3. DECLAR. COMPROM. ENTREGA - Firmado.pdf
2	Acreditaciones fabricante Lote 1.pdf	Anexo Compromiso Camas En Deposito Fdo.pdf	1.1 Documentación Advantcare_Lote1_Canarias_Jul23_LR.pdf	0 Anexo_I_Oferta_economica.pdf	0. Anexo_I_Oferta_economica.pdf	4. DECLAR. COMPROM. FABRIC - Firmado.pdf
3	Anexo I. Oferta economica.pdf	Anexo Compromiso de Fabricación Fdo.pdf	1.3 Camas en deposito y plazo garantía.pdf	2021 ISO_9001_LINET IBERIA.pdf	2. Anexo_VI_Oferta_criterios_adjudicación.pdf	5. DECLAR. COMPROM. MANTENI - Firmado.pdf
4	ANEXO V Declaración relativa a la subcontratación.pdf	Anexo Compromiso Entrega Fdo.pdf	2. Anexo_VI_Oferta_criterios_adjudicación.pdf	2021 ISO_14001_LINET IBERIA.pdf	3. D. Responsable cumplimiento condiciones entrega.pdf	6. CONDICIONES GARANTIA - Firmado.pdf
5	Anexo VI. Criterios de adjudicación..pdf	Anexo Compromiso Mantenimiento Equipos Ofertados Fdo.pdf	3. Compromiso de entrega.pdf	Anexo_V_Declaración_subcontratación.pdf	4. Declaración responsable equipos nuevos.pdf	7. INFOR. ACCESORIOS Y FUNGIBLES - Firmado.pdf

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

6	Compromiso de fabricacion.pdf	Anexo Condicion Especial de Ejecucion Fdo.pdf	4. Compromiso de fabricacion.pdf	Anexo_VI_Oferta_criterios_adjudicacion.pdf	5. DECLARACION RESPONSABLE_ repuestos.pdf	8. CUMPLIM. NORMATIVA - Firmado.pdf
7	Compromiso mantenimiento elementos ofertados..pdf	Anexo Condiciones Garantia Fdo.pdf	5. Compromiso de mantenimiento de elementos ofertados y repuestos.pdf	Cama Essenza 300 - Declaracion de conformidad.pdf	6. Condiciones de garantia_plazo mantenimiento adscripcion medios.pdf	9. FORMACION - Firmado.pdf
8	Condicion especial de ejecucion..pdf	Anexo I Oferta Economica Fdo.pdf	6. Condiciones de garantia.pdf	Compromiso formacion.pdf	7.FUNGIBLES-REPUESTOS GALAXY 3.pdf	10. CONDIC. ESPECIAL. EJECUCION - Firmado.pdf
9	Condiciones de garantia.pdf	Anexo V Declaracion Subcontratacion Fdo.pdf	7. Accesorios y fungibles.pdf	Condicion especial de ejecucion.pdf	8.Memoria Calidad. ISO. CE.pdf	AE1 Lote 1 Descripción y Características Técnicas_compressed - Firmado.pdf
10	Cumplimiento de condiciones generales. Compromiso de entrega..pdf	Anexo VI Oferta Criterios Adjudicacion Fdo.pdf	8. Cumplimiento de la normativa.pdf	Declaracion compromiso de entrega.pdf	9.FORMACION MEDICAL IBERICA.pdf	ANEXO I PROP. ECONOM - Firmado.pdf
11	Ficha tecnica Lote 1.pdf	Cumplimiento Normativas.pdf	9. Formacion.pdf	Declaracion compromiso de fabricacion.pdf	10. D. responsable_Condiciones_especiales_ejecucion.pdf	ANEXO V DECLAR. SUBCONTR. - Firmado.pdf
12	Formacion. Propuesta detallada.pdf	CURA 4040 Manual de Usuario.pdf	10. Condiciones especiales de ejecucion.pdf	Declaracion compromiso mantenimiento elementos ofertados.pdf	11. Anexo_V_Declaracion_subcontratacion.pdf	ANEXO VI CRITER. ADJUDIC - Firmado.pdf
13	Listado de accesorios Lote 1.pdf	FICHA TECNICA PRODUCTOS OFERTADOS.pdf	11. Anexo_V_Declaracion_subcontratacion.pdf	Declaracion condiciones de la garantia.pdf		DECLAR. CATALOG. CAMILLA TRANSTAR LOTE 3 - Pag. catalogo.pdf
14	Manual de servicio Lote 1.pdf	PROPUESTA DETALLADA DE LA OFERTA FORMATIVA Fdo.pdf	0. Anexo_I_Oferta_economica.pdf	1.Oferta tecnica Lote 1.pdf		Lote 1 Catalogo colchon NP150.pdf
15	Manual de uso Lote 1.pdf			2.Catalogo Essenza ES.pdf		Lote 1 HR900 Especificaciones Técnicas Todos Modelos.pdf
16	Normativa Aplicable.pdf			3.Product data Essenza 300.pdf		Lote 1 HR900n3 catalogo barandilla partida.pdf
17	Normativa Lote 1.pdf			4.Viskomatt 10 - Ficha Tecnica.pdf		Lote 1 Manual uso HR900.pdf
18	Oferta tecnica Lote 1.pdf			5.Ficha almohada Visco Sonia y funda.pdf		Lote 1 y 3 PPT FICHAS TECNICAS - Firmado.pdf

2. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES GENERALES Y DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS (apartado 15.2.2. del PCAP)

El documento correspondiente de la oferta, presentado por cada licitador, se identifica entre paréntesis según tabla 1 del apartado anterior.

2.1 Oferta Técnica:

Documentación que indique claramente el cumplimiento de cada una de las características técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con indicación de aquellas que superen los requerimientos mínimos, expresándolas en las mismas unidades utilizadas en el Pliego,

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

con indicación de la norma de referencia para la medición. Deberá proporcionarse la máxima descripción, catálogos, hojas de datos técnicos (*product data*), e información que permita verificar el cumplimiento de dichas características y realizar una completa valoración de la oferta presentada. **Asimismo, se incluirá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación cualitativos.**

Los ofertantes podrán añadir a la información solicitada, cuanta información técnica, comercial o de operación y uso consideren conveniente para facilitar el conocimiento y evaluación de las características y prestaciones de los equipos ofertados, teniendo en cuenta que el contenido de toda la documentación incluida o adjunta a las ofertas formará parte de los compromisos contractuales y consecuentemente, de las obligaciones como contratista, en caso de resultar adjudicatarios.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (18, 11, 14 y 15)	Documento (13)	Documento (2)	Documento (14,15,16,17 y 18)	Documento (1)	Documento (14, 15,16,17 y 18)

2.2. Criterios de adjudicación

ANEXO VI de este Pliego debidamente cumplimentado.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (5)	Documento (10)	Documento (4)	Documento (6)	Documento (3)	Documento (12)

2.3. Compromiso de entrega:

Compromisos del licitador para cumplir las condiciones establecidas para la entrega de los elementos, en los términos de plazos, lugares de entrega y montaje, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (10)	Documento (4)	Documento (5)	Documento (10)	Documento (4)	Documento (1)

2.4 Compromiso de fabricación:

Declaración responsable de que el equipamiento ofertado es de fabricación nueva y compromiso de que la fecha de fabricación del equipamiento a entregar, en ningún caso será anterior a 24 meses contados desde la fecha de entrega del material al Hospital, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (6)	Documento (3)	Documento (6)	Documento (11)	Documento (5)	Documento (2)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

2.5. Compromiso mantenimiento elementos ofertados y repuestos

Compromiso del licitador de mantener los elementos ofertados disponibles en el mercado durante un período mínimo de cinco años y los componentes y repuestos, durante un período de 10 años, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (7) ^{1*}	Documento (5) ^{2*}	Documento (7) ^{3*}	Documento (12) ^{4*}	Documento (6 y 7) ^{5*}	Documento (3) ^{6*}

^{1*} ... los componentes y repuestos, durante un período de 10 años.

^{2*} ... servicio de repuestos contra cargo por 10 años.

^{3*} ...los componentes y repuestos durante un periodo mínimo de 10 años.

^{4*} ...repuestos, durante un período de 10 años.

^{5*} ...disponibilidad de repuestos originales, accesorios, ... durante un período mínimo de 10 años.

^{6*} ... repuestos, durante un período de 10 años.

2.6. Condiciones de la garantía

Plazos y condiciones de la garantía (incluyendo el alcance del mantenimiento preventivo y la propuesta del cronograma de ejecución del mismo), así como descripción de los recursos humanos y materiales de que disponen para la prestación del servicio de asistencia técnica de postventa y sus compromisos en materia de tiempo de respuesta técnica, tiempo de resolución, disponibilidad de repuestos, etc., de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (9) ^{1*}	Documento (7)	Documento (1 y 8) ^{3*}	Documento (13) ^{4*}	Documento (2 y 7) ^{5*}	Documento (4 y 10) ^{6*}

^{1*} 6 años (3 años mínimo + 3 años ampliación).


^{2*} La garantía ofrecida para los diferentes equipos ofertados es de 5 años, dos años más sobre el mínimo requerido en el Pliego.

^{3*} ... total 96 meses, ampliación de 5 años sobre el mínimo exigido.

^{4*} ... 36 + 60 = 96 meses de garantía total.

^{5*} ... (mínimo 36 meses + 60 meses de ampliación).

^{6*} ...36 meses + 60 meses. Total 96 meses.

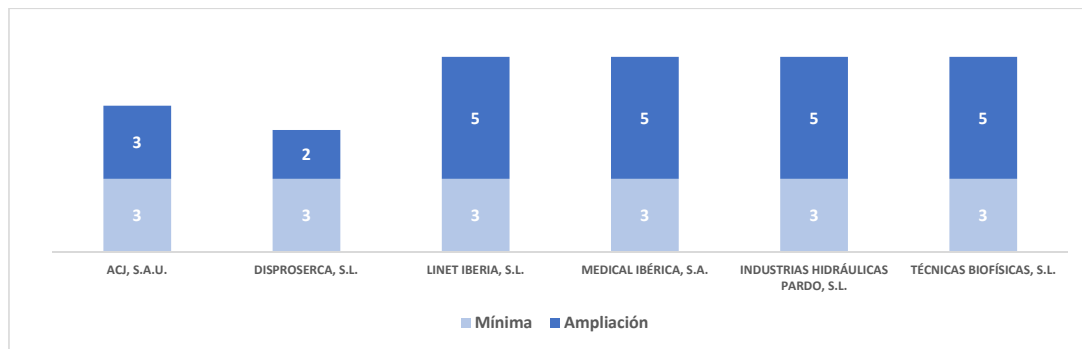

2.7. Información sobre accesorios y fungibles

Información complementaria referente al material fungible y accesorio asociados al equipamiento objeto de adquisición, de conformidad con lo establecido en la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (13)	Documento (1)	Documento (9)	Documento (1)	Documento (8)	Documento (5)

2.8. Cumplimiento de la normativa

Documentación acreditativa de que los equipos cumplen los requisitos legales y normativas vigentes, así como las normas de calidad superadas por los elementos a suministrar, de conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (16)	Documento (11)	Documento (10)	Documento (7)	Documento (9)	Documento (6)

2.9 Formación

Propuesta detallada del alcance, contenido, metodología y lugar de celebración de la formación a impartir en los centros hospitalarios de destino del equipamiento, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (12)	Documento (14)	Documento (11)	Documento (8)	Documento (10)	Documento (7)

2.10. Condición especial de ejecución

Declaración responsable del licitador por la que se compromete, en relación a la recogida de envases y embalajes que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, a responsabilizarse de una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato, que incluirá la retirada de los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado, de conformidad con lo establecido en la cláusula 25.4 del presente Pliego.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (8)	Documento (6)	Documento (12)	Documento (9)	Documento (11)	Documento (8)

2.11. Subcontratación:

Se ha de incluir en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 30 del presente pliego y cuyo modelo se adjunta al mismo como ANEXO.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (4) ¹	Documento (9) ²	Documento (13) ³	Documento (5) ⁴	Documento (12) ⁵	Documento (11) ⁶

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TÉCNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

- 1^o Que en la oferta presentada no se va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.
2^o Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.
3^o Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.
4^o Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.
5^o Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.
6^o Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

3. EVALUACIÓN TÉCNICA

A continuación se analiza el cumplimiento de las características establecidas como mínimas en las fichas técnicas del apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), para el **LOTE 1** del equipamiento del presente expediente.

Los resultados de dicho análisis, ofrecen los incumplimientos a continuación señalados para cada una de las propuestas presentadas por cada licitador a través de la documentación técnica aportada así como de la inspección y comprobación con las muestras entregadas en cada uno de los centros hospitalarios de referencia exigidos:

3.1. ACJ, SAU

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

SOMIER

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Paneles fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas y fabricados en laminado de alta presión (HPL). 	<ul style="list-style-type: none"> • Panel NO desmontable sin necesidad de herramientas y no todos los paneles están fabricados en laminado de alta presión (HPL).

BARANDILLA

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Mandos integrados en barandillas, en ambos lados, izquierdo y derecho, y en su cara interior y exterior, que mantengan orientación independientemente de su posición: <ul style="list-style-type: none"> o La cara interior de las barandillas dispondrá de mandos integrados cuyas acciones únicamente incluirán los movimientos básicos y NUNCA aquellas acciones para posiciones terapéuticas programadas que solo deben ser manejadas desde el mando para el personal sanitario. o La cara exterior de las barandillas dispondrá de mandos integrados con todas las funciones disponibles, incluidos los bloqueos de las articulaciones de la cama. Entre las funciones disponibles será posible, como mínimo, las siguientes posiciones: silla cardíaca, Trendelenburg y antitrendelenburg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los bloqueos de las articulaciones de la cama están únicamente en el mando del piecero.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Como medida de protección contra contactos eléctricos indirectos, la cama deberá disponer de protección a tierra en todas las superficies metálicas (chasis y articulaciones). Asimismo, la cama dispondrá de terminal de conexión equipotencial 	<ul style="list-style-type: none"> No todas las superficies metálicas disponen de protección a tierra.
<ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación de cada cama será tipo espiral con fuerza de recuperación elevada y libre de halógenos. Así mismo, para evitar el arrastre del cable durante el desplazamiento de la cama, se dispondrá de soporte para su sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> No dispone de soporte para sujeción del cable

DISEÑO

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Cabeceros y pieceros provistos de sistema de fijación y fácilmente extraíbles sin uso de herramientas 	<ul style="list-style-type: none"> El mando incluido en el piecero impide que su extracción sea fácil y sin uso de herramientas.
<ul style="list-style-type: none"> El cabecero deberá estar unido al chasis de la cama e independiente de la subida y bajada de la misma, es decir, NUNCA le influirá el movimiento de las partes articuladas, SIEMPRE estará en una posición fija 	<ul style="list-style-type: none"> El cabecero no está unido al chasis
<ul style="list-style-type: none"> Todos los mandos deben estar integrados en la propia cama. No se admitirán camas con mandos "satélite" o similar 	<ul style="list-style-type: none"> No todos los mandos están integrados en la cama

COLCHÓN Y ALMOHADAS

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Espesor entre 14 y 16 cm 	<ul style="list-style-type: none"> El espesor del colchón presentado es de 12 cm de espesor.
<ul style="list-style-type: none"> Dotación de almohada: o Material: 100% viscoelástica. o Adaptada al dimensionado y a los movimientos del colchón. La funda de cada almohada deberá ser extraíble y deberá permitir limpiarse con productos desinfectantes hospitalarios 	<ul style="list-style-type: none"> NO presenta muestra de almohada para su comprobación

3.2. DISPROSERCA, SL

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

POSICIONES

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Sistema abatimiento emergencia, a ambos lados de la cama, y amortiguado. Los motores de la cama dispondrán de desembague manual de emergencia CPR. Con 	<ul style="list-style-type: none"> La palanca de CPR no está identificada con las siglas correspondientes

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



el fin de facilitar la labor del personal sanitario en situaciones de estrés, la palanca de CPR debe estar identificada con las siglas "CPR".	
---	--

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Como medida de protección contra contactos eléctricos indirectos, la cama deberá disponer de protección a tierra en todas las superficies metálicas (chasis y articulaciones). Asimismo, la cama dispondrá de terminal de conexión equipotencial 	<ul style="list-style-type: none"> • No tiene terminal de conexión equipotencial.
<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación de cada cama será tipo espiral con fuerza de recuperación elevada y libre de halógenos. Así mismo, para evitar el arrastre del cable durante el desplazamiento de la cama, se dispondrá de soporte para su sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación no es tipo espiral.

DISEÑO

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los mandos deben estar integrados en la propia cama. No se admitirán camas con mandos "satélite" o similar 	<ul style="list-style-type: none"> • No todos los mandos están integrados en la cama

MOVIMIENTOS BÁSICOS

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • La sección de pies dispondrá de la posibilidad de descenso manual. 	<ul style="list-style-type: none"> • No es posible bajar la sección de pies

3.3. INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, SL

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

BARANDILLA

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Mandos integrados en barandillas, en ambos lados, izquierdo y derecho, y en su cara interior y exterior, que mantengan orientación independientemente de su posición: o La cara interior de las barandillas dispondrá de mandos integrados cuyas acciones únicamente incluirán los movimientos básicos y NUNCA aquellas acciones para posiciones terapéuticas programadas que solo deben 	<ul style="list-style-type: none"> • La función de 'silla cardiaca' no la hace correctamente ya que se eleva la sección de pies.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

<p>ser manejadas desde el mando para el personal sanitario.</p> <p>o La cara exterior de las barandillas dispondrá de mandos integrados con todas las funciones disponibles, incluidos los bloqueos de las articulaciones de la cama. Entre las funciones disponibles será posible, como mínimo, las siguientes posiciones: silla cardíaca, Trendelenburg y antitrendelenburg.</p>	
--	--

MOVIMIENTOS BÁSICOS

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • La sección de pies dispondrá de la posibilidad de descenso manual. 	<ul style="list-style-type: none"> • No es posible bajar la sección de pies

3.4. LINET IBERIA, SL

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

DIMENSION EXTERIOR

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Altura libre entre el suelo y chasis mayor o igual a 15 cm, siendo esta altura la existente entre el suelo y cualquier elemento de la cama (chasis, motores, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • La altura libre es de 5 cm

SOMIER

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Paneles fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas y fabricados en laminado de alta presión (HPL). 	<ul style="list-style-type: none"> • Los paneles NO están fabricados en laminado de alta presión (HPL).

DISEÑO

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • El cabecero deberá estar unido al chasis de la cama e independiente de la subida y bajada de la misma, es decir, NUNCA le influirá el movimiento de las partes articuladas, SIEMPRE estará en una posición fija 	<ul style="list-style-type: none"> • El cabecero no está unido al chasis
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los mandos deben estar integrados en la propia cama. No se admitirán camas con mandos "satélite" o similar 	<ul style="list-style-type: none"> • No todos los mandos están integrados en la cama

MOVIMIENTOS BÁSICOS



EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Flexión de rodillas eléctrica con elevación automática, de manera también eléctrica, de la sección de los pies. 	<ul style="list-style-type: none"> La sección de pies no se eleva de forma automática.

COMPLEMENTOS INCLUIDOS

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Equipado de topes de protección ante choques de tacos rodantes o similar 	<ul style="list-style-type: none"> Los topes de la zona del cabecero son fijos.

3.5. MEDICAL IBERIA, SA

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

DIMENSION EXTERIOR

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Altura libre entre el suelo y chasis mayor o igual a 15 cm, siendo esta altura la existente entre el suelo y cualquier elemento de la cama (chasis, motores, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> La altura libre es de 12 cm

POSICIONES

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Sistema abatimiento emergencia, a ambos lados de la cama, y amortiguado. Los motores de la cama dispondrán de desembague manual de emergencia CPR. Con el fin de facilitar la labor del personal sanitario en situaciones de estrés, la palanca de CPR debe estar identificada con las siglas "CPR". 	<ul style="list-style-type: none"> La palanca de CPR no está identificada con las siglas correspondientes

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación de cada cama será tipo espiral con fuerza de recuperación elevada y libre de halógenos. Así mismo, para evitar el arrastre del cable durante el desplazamiento de la cama, se dispondrá de soporte para su sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación no es tipo espiral.

DISEÑO

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Todos los mandos deben estar integrados en la propia cama. No se admitirán camas con mandos "satélite" o similar 	<ul style="list-style-type: none"> No todos los mandos están integrados en la cama

MOVIMIENTOS BÁSICOS

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



EXIGIDO	OFERTADO
• Flexión de rodillas eléctrica con elevación automática, de manera también eléctrica, de la sección de los pies.	• La sección de pies no se eleva de forma automática.

3.6. TÉCNICAS BIOFÍSICAS, SL

La propuesta presentada por esta empresa cumple los requisitos técnicos mínimos exigidos.

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

- 13 -

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES

A tenor del análisis realizado en el apartado anterior, a continuación se barema únicamente las ofertas admitidas, pues cumplen los requisitos mínimos exigidos.

La mejor relación calidad precio en la ejecución del contrato, se evalúa mediante la valoración de los siguientes criterios de adjudicación, con arreglo a lo descrito en el apartado 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación:

LOTE 1.- CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 1		Técnicas Biofísicas S.L.	
CRITERIOS CUALITATIVOS			
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES		65 puntos	54
2.1 Dotación de camas en depósito en el Hospital, durante el periodo de garantía (número de camas)	8		8 10 camas
2.2 Restablecimiento, de manera eléctrica, de condiciones iniciales (cama en horizontal) presionando únicamente un botón de los mandos de la cama	6		6 SI
2.3 Alarma de pedal de freno que indicará que la cama está conectada a la red eléctrica pero no está frenada	6		6 SI
2.4 Luz de noche incluida en todas las camas con cambios de color.	6		6 SI
2.5 Colchón encapsulado	6		6 SI
2.6 Mayor número de movimientos programados (funciones automáticas preprogramadas activadas mediante desbloqueo)	6		6 SI
2.7 Capacidad de acoplamiento a sistema de transporte mecánico.	6		6 SI
2.8 Quinta rueda motorizada	6		0 NO
2.9 Espacio ocupado en la activación (recorrido y situación finalista) de las barandillas inferior a 7 cm	5		5 4 cm
2.10 Dispone, mediante accionamiento eléctrico, de sistema de lateralización del paciente	5		0 NO
2.11 Ampliación del periodo de garantía	5		5 96 meses

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20

5. CONCLUSIONES

Las ofertas presentadas por las empresas licitadoras:

- ACJ, SAU.
- DISPROSERCA, S.L.
- LINET IBERIA, SL
- MEDICAL IBERICA, SA
- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.:

no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas; mientras que el licitador:

- TECNICAS BIOFISICAS SL

Sí cumple con las características mínimas requeridas.

En cuanto a los criterios cualitativos, a excepción del criterio económico, la puntuación otorgada a la empresa que cumple los requisitos exigidos acorde al cuadro anterior asciende a cincuenta y cuatro (54) puntos.

Lo que se traslada a la mesa de contratación para su conocimiento y efectos oportunos.

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

- 15 -

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:44

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0tZYvqVVmh3Qj-W8FkZepj5nQf3I8K01Y



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:20



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS ECONÓMICOS



Cofinanciado por la Unión Europea

EXPEDIENTE:

23/S/23/SU/CO/A/R03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. EXPEDIENTE COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 85% PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2021-2027.

LOTE II

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQNPNBcFJBp8otefIJxB



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22

TABLA DE CONTENIDO

1. EMPRESAS OFERTANTES / OFERTAS	- 3 -
1.1 Los documentos estudiados correspondientes a cada oferta son los siguientes:.....	- 3 -
2. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES GENERALES Y DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS (apartado 15.2.2. del PCAP)	- 4 -
2.1 Oferta Técnica:	- 4 -
2.2. Criterios de adjudicación	- 4 -
2.3. Compromiso de entrega:.....	- 5 -
2.4 Compromiso de fabricación:.....	- 5 -
2.5. Compromiso mantenimiento elementos ofertados y repuestos	- 5 -
2.6. Condiciones de la garantía	- 5 -
2.7. Información sobre accesorios y fungibles	- 6 -
2.8. Cumplimiento de la normativa	- 6 -
2.9 Formación	- 6 -
2.10. Condición especial de ejecución.....	- 7 -
2.11. Subcontratación:	- 7 -
3. EVALUACIÓN TÉCNICA	- 7 -
3.1. DISPROSERCA, SL.....	- 7 -
3.2. INDUSTRIAS HADRÁULICAS PARDO, SL.....	- 8 -
3.3. LINET IBERIA, SL	- 9 -
3.4. MEDICAL IBERIA, SA	- 10 -
4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES	- 11 -
5. CONCLUSIONES.....	- 11 -


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQNPBcFJBp8otefIJxB



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22

1. EMPRESAS OFERTANTES / OFERTAS

Se han analizado las siguientes ofertas y equipos correspondientes al Lote II:

OFERTA	EQUIPO OFERTADO	MUESTRAS	IMAGEN
DISPROSERCA, S.L.	MARCA: SCHRÖDER MODELO: CURA 4040	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	MARCA: PARDO MODELO: ADVANTCARE	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
LINET IBERIA, S.L.	MARCA: LINET MODELO: ESSENZA 300	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
MEDICAL IBÉRICA, S.A.	MARCA: MEDISA MODELO: GALAXY 3	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	

1.1 Los documentos estudiados correspondientes a cada oferta son los siguientes:

Tabla 1. Documentación presentada (57 documentos correspondientes a seis ofertas):

N.º	DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
1	Anexo Accesorios Fdo.pdf	0. Anexo_I_Oferta_economica.pdf	Declaracion fungibles y accesorios.pdf	OFERTA TECNICA MEDICAL IBERICA. Lote 1.Lote2.pdf
2	Anexo Compromiso Camas En Deposito Fdo.pdf	1.1 Documentacion_Advancare_Lote2_Canarias_Jul23_LR.pdf	0 Anexo_I_Oferta_economica.pdf	0. Anexo_I_Oferta_economica.pdf
3	Anexo Compromiso de Fabricacion Fdo.pdf	1.3 Camas en deposito y plazo garantia.pdf	2021 ISO_9001_LINET IBERIA.pdf	2. Anexo_VI_Oferta_criterios_adjudicacion.pdf
4	Anexo Compromiso Entrega Fdo.pdf	2. Anexo_VI_Oferta_criterios_adjudicacion.pdf	2021 ISO_14001_LINET IBERIA.pdf	3. D. Responsable cumplimiento condiciones entrega.pdf
5	Anexo Compromiso Mantenimiento Equipos Ofertados Fdo.pdf	3. Compromiso de entrega.pdf	Anexo_V_Declaracion_subcontratacion.pdf	4. Declaracion responsable equipos nuevos.pdf
6	Anexo Condicion Especial de Ejecucion Fdo.pdf	4. Compromiso de fabricacion.pdf	Anexo_VI_Oferta_criterios_adjudicacion.pdf	5. DECLARACION RESPONSABLE_ repuestos.pdf
7	Anexo Condiciones Garantia Fdo.pdf	5. Compromiso de mantenimiento de elementos ofertados y repuestos.pdf	Cama Essenza 300 - Declaracion de conformidad.pdf	6. Condiciones de garantia_plazo mantenimiento adscripcion medios.pdf
8	Anexo I Oferta Economica Fdo.pdf	6. Condiciones de garantia.pdf	Compromiso formacion.pdf	7.FUNGIBLES-REPUESTOS GALAXY 3.pdf
9	Anexo V Declaracion Subcontratacion Fdo.pdf	7. Accesorios y fungibles.pdf	Condicion especial de ejecucion.pdf	8.Memoria Calidad. ISO. CE.pdf
10	Anexo VI Oferta Criterios Adjudicacion Fdo.pdf	8. Cumplimiento de la normativa.pdf	Declaracion compromiso de entrega.pdf	9.FORMACION MEDICAL IBERICA.pdf


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQNPBcFJbP8otefIJxB



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22

11	Cumplimiento Normativas.pdf	9. Formacion.pdf	Declaracion compromiso de fabricacion.pdf	10. D. responsable_Condiciones_especiales_ejecucion.pdf
12	CYCLOONE -Manual de Usuario.pdf	10. Condiciones especiales de ejecucion.pdf	Declaracion compromiso mantenimiento elementos ofertados.pdf	11. Anexo_V_Declaracion_subcontratacion.pdf
13	FICHA TÉCNICA PRODUCTOS OFERTADOS.pdf	11. Anexo_V_Declaracion_subcontratacion.pdf	Declaracion condiciones de la garantia.pdf	
14	PROPUESTA DETALLADA DE LA OFERTA FORMATIVA Fdo.pdf	0. Anexo_I_Oferta_economica.pdf	1.Oferta tecnica Lote 2.pdf	
15			2.Catalogo Essenza.pdf	
16			3.Product data Essenza 300.pdf	
17				
18			5.Ficha almohada Visco Sonia y funda.pdf	

2. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES GENERALES Y DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS (apartado 15.2.2. del PCAP)

El documento correspondiente de la oferta, presentado por cada licitador, se identifica entre paréntesis según tabla 1 del apartado anterior.

2.1 Oferta Técnica:

Documentación que indique claramente el cumplimiento de cada una de las características técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con indicación de aquellas que superen los requerimientos mínimos, expresándolas en las mismas unidades utilizadas en el Pliego, con indicación de la norma de referencia para la medición. Deberá proporcionarse la máxima descripción, catálogos, hojas de datos técnicos (*product data*), e información que permita verificar el cumplimiento de dichas características y realizar una completa valoración de la oferta presentada. **Asimismo, se incluirá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación cualitativos.**

Los ofertantes podrán añadir a la información solicitada, cuanta información técnica, comercial o de operación y uso consideren conveniente para facilitar el conocimiento y evaluación de las características y prestaciones de los equipos ofertados, teniendo en cuenta que el contenido de toda la documentación incluida o adjunta a las ofertas formará parte de los compromisos contractuales y consecuentemente, de las obligaciones como contratista, en caso de resultar adjudicatarios.

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (13)	Documento (2)	Documento (14,15,16 y 18)	Documento (1)

2.2. Criterios de adjudicación

ANEXO VI de este Pliego debidamente cumplimentado.

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (10)	Documento (4)	Documento (6)	Documento (3)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQPNBcFJBp8otefIJxB



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22

2.3. Compromiso de entrega:

Compromisos del licitador para cumplir las condiciones establecidas para la entrega de los elementos, en los términos de plazos, lugares de entrega y montaje, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (4)	Documento (5)	Documento (10)	Documento (4)

2.4 Compromiso de fabricación:

Declaración responsable de que el equipamiento ofertado es de fabricación nueva y compromiso de que la fecha de fabricación del equipamiento a entregar, en ningún caso será anterior a 24 meses contados desde la fecha de entrega del material al Hospital, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (3)	Documento (6)	Documento (11)	Documento (5)

2.5. Compromiso mantenimiento elementos ofertados y repuestos

Compromiso del licitador de mantener los elementos ofertados disponibles en el mercado durante un período mínimo de cinco años y los componentes y repuestos, durante un período de 10 años, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (5) ^{1*}	Documento (7) ^{2*}	Documento (12) ^{3*}	Documento (6 y 7) ^{4*}

^{1*} ... servicio de repuestos contra cargo por 10 años.

^{2*} ...los componentes y repuestos durante un periodo mínimo de 10 años.

^{3*} ...repuestos, durante un período de 10 año.

^{4*} ...disponibilidad de repuestos originales, accesorios, ... durante un período mínimo de 10 años.

2.6. Condiciones de la garantía

Plazos y condiciones de la garantía (incluyendo el alcance del mantenimiento preventivo y la propuesta del cronograma de ejecución del mismo), así como descripción de los recursos humanos y materiales de que disponen para la prestación del servicio de asistencia técnica de postventa y sus compromisos en materia de tiempo de respuesta técnica, tiempo de resolución, disponibilidad de repuestos, etc., de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (7 y 8) ^{1*}	Documento (1 y 8) ^{2*}	Documento (2 y 13) ^{3*}	Documento (2 y 7) ^{4*}

^{1*} La garantía ofrecida para los diferentes equipos ofertados es de 5 años, dos años más sobre el mínimo requerido en el Pliego.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQNPNCfJBP8otefIJxB




El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22

²... total 96 meses, ampliación de 5 años sobre el mínimo exigido.

³... 36 + 60 = 96 meses de garantía total.

⁴...(mínimo 36 meses + 60 meses de ampliación).

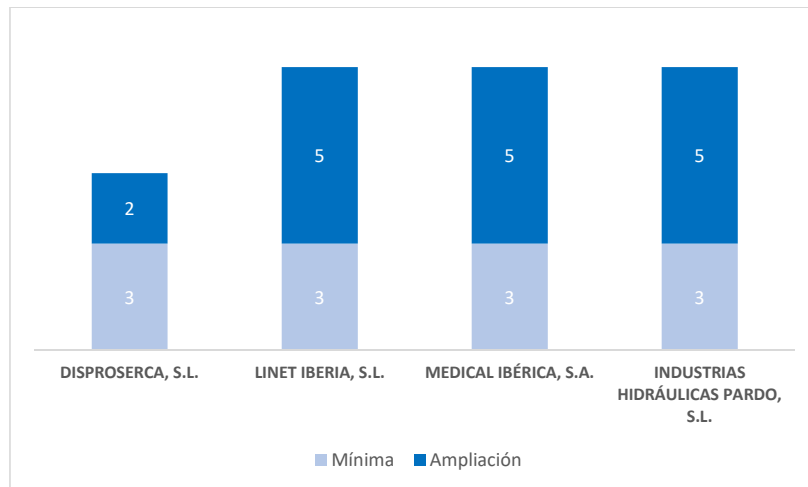

2.7. Información sobre accesorios y fungibles

Información complementaria referente al material fungible y accesorio asociados al equipamiento objeto de adquisición, de conformidad con lo establecido en la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (1)	Documento (9)	Documento (1)	Documento (8)

2.8. Cumplimiento de la normativa

Documentación acreditativa de que los equipos cumplen los requisitos legales y normativas vigentes, así como las normas de calidad superadas por los elementos a suministrar, de conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (11)	Documento (10)	Documento (7)	Documento (9)

2.9 Formación

Propuesta detallada del alcance, contenido, metodología y lugar de celebración de la formación a impartir en los centros hospitalarios de destino del equipamiento, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (14)	Documento (11)	Documento (8)	Documento (10)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQNPBcFJBp8otefIJxB



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22

2.10. Condición especial de ejecución

Declaración responsable del licitador por la que se compromete, en relación a la recogida de envases y embalajes que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, a responsabilizarse de una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato, que incluirá la retirada de los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado, de conformidad con lo establecido en la cláusula 25.4 del presente Pliego.

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (6)	Documento (12)	Documento (9)	Documento (11)

2.11. Subcontratación:

Se ha de incluir en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 30 del presente pliego y cuyo modelo se adjunta al mismo como ANEXO.

DISPROSERCA, S.L.	INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	MEDICAL IBÉRICA, S.A.
Documento (9) ^{1*}	Documento (13) ^{2*}	Documento (5) ^{3*}	Documento (12) ^{4*}

^{1*} Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

^{2*} Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

^{3*} Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

^{4*} Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

3. EVALUACIÓN TÉCNICA

A continuación se analiza el cumplimiento de las características establecidas como mínimas en las fichas técnicas del apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), para el **LOTE 2** del equipamiento del presente expediente.

Los resultados de dicho análisis, ofrecen los incumplimientos a continuación señalados para cada una de las propuestas presentadas por cada licitador a través de la documentación técnica aportada así como de la inspección y comprobación con las muestras entregadas en cada uno de los centros hospitalarios de referencia exigidos:

3.1. DISPROSERCA, SL

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

DIMENSIÓN EXTERIOR

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> Ancho máximo, independientemente de la posición elevada o baja de la barandilla o Ancho máximo 98 cm. o Largo máximo 220 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> El ancho de la cama es de 100 cm

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

- 7 -

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQNPBcFJBp8otefIJxB



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22

POSICIONES

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema abatimiento emergencia, a ambos lados de la cama, y amortiguado. Los motores de la cama dispondrán de desembague manual de emergencia CPR. Con el fin de facilitar la labor del personal sanitario en situaciones de estrés, la palanca de CPR debe estar identificada con las siglas "CPR". 	<ul style="list-style-type: none"> • La palanca de CPR no está identificada con las siglas correspondientes

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Como medida de protección contra contactos eléctricos indirectos, la cama deberá disponer de protección a tierra en todas las superficies metálicas (chasis y articulaciones). Asimismo, la cama dispondrá de terminal de conexión equipotencial 	<ul style="list-style-type: none"> • No tiene terminal de conexión equipotencial.
<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación de cada cama será tipo espiral con fuerza de recuperación elevada y libre de halógenos. Así mismo, para evitar el arrastre del cable durante el desplazamiento de la cama, se dispondrá de soporte para su sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación no es tipo espiral.

DISEÑO

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los mandos deben estar integrados en la propia cama. No se admitirán camas con mandos "satélite" o similar 	<ul style="list-style-type: none"> • No todos los mandos están integrados en la cama

MOVIMIENTOS BÁSICOS


EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • La sección de pies dispondrá de la posibilidad de descenso manual. 	<ul style="list-style-type: none"> • No es posible bajar la sección de pies

3.2. INDUSTRIAS HADRÁULICAS PARDO, SL

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

BARANDILLA

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Mandos integrados en barandillas, en ambos lados, izquierdo y derecho, y en su cara interior y exterior, que 	<ul style="list-style-type: none"> • La función de 'silla cardiaca' no la hace correctamente ya que se eleva la sección de pies.



<p>mantengan orientación independientemente de su posición:</p> <p>o La cara interior de las barandillas dispondrá de mandos integrados cuyas acciones únicamente incluirán los movimientos básicos y NUNCA aquellas acciones para posiciones terapéuticas programadas que solo deben ser manejadas desde el mando para el personal sanitario.</p> <p>o La cara exterior de las barandillas dispondrá de mandos integrados con todas las funciones disponibles, incluidos los bloqueos de las articulaciones de la cama. Entre las funciones disponibles será posible, como mínimo, las siguientes posiciones: silla cardíaca, Trendelenburg y antitrendelenburg.</p>	
---	--

MOVIMIENTOS BÁSICOS

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • La sección de pies dispondrá de la posibilidad de descenso manual. 	<ul style="list-style-type: none"> • No es posible bajar la sección de pies

3.3. LINET IBERIA, SL

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

DIMENSION EXTERIOR

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Altura libre entre el suelo y chasis mayor o igual a 15 cm, siendo esta altura la existente entre el suelo y cualquier elemento de la cama (chasis, motores, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • La altura libre es de 5 cm

SOMIER

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Paneles fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas y fabricados en laminado de alta presión (HPL). 	<ul style="list-style-type: none"> • Los paneles NO están fabricados en laminado de alta presión (HPL).

DISEÑO

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • El cabecero deberá estar unido al chasis de la cama e independiente de la subida y bajada de la misma, es decir, NUNCA le influirá el movimiento de las partes articuladas, SIEMPRE estará en una posición fija 	<ul style="list-style-type: none"> • El cabecero no está unido al chasis


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQNPBcFJBp8otefIJxB



<ul style="list-style-type: none"> • Todos los mandos deben estar integrados en la propia cama. No se admitirán camas con mandos “satélite” o similar 	<ul style="list-style-type: none"> • No todos los mandos están integrados en la cama
--	---

MOVIMIENTOS BÁSICOS

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Flexión de rodillas eléctrica con elevación automática, de manera también eléctrica, de la sección de los pies. 	<ul style="list-style-type: none"> • La sección de pies no se eleva de forma automática.

COMPLEMENTOS INCLUIDOS

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Equipado de topes de protección ante choques de tacos rodantes o similar 	<ul style="list-style-type: none"> • Los topes de la zona del cabecero son fijos.

3.4. MEDICAL IBERIA, SA

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

DIMENSION EXTERIOR

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Altura libre entre el suelo y chasis mayor o igual a 15 cm, siendo esta altura la existente entre el suelo y cualquier elemento de la cama (chasis, motores, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • La altura libre es de 12 cm

POSICIONES

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema abatimiento emergencia, a ambos lados de la cama, y amortiguado. Los motores de la cama dispondrán de desembague manual de emergencia CPR. Con el fin de facilitar la labor del personal sanitario en situaciones de estrés, la palanca de CPR debe estar identificada con las siglas “CPR”. 	<ul style="list-style-type: none"> • La palanca de CPR no está identificada con las siglas correspondientes

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

<i>EXIGIDO</i>	<i>OFERTADO</i>
<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación de cada cama será tipo espiral con fuerza de recuperación elevada y libre de halógenos. Así mismo, para evitar el arrastre del cable durante el desplazamiento de la cama, se dispondrá de soporte para su sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación no es tipo espiral.


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQNPNBcFJBp8otefIJxB



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22

DISEÑO

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los mandos deben estar integrados en la propia cama. No se admitirán camas con mandos “satélite” o similar 	<ul style="list-style-type: none"> • No todos los mandos están integrados en la cama

MOVIMIENTOS BÁSICOS

EXIGIDO	OFERTADO
<ul style="list-style-type: none"> • Flexión de rodillas eléctrica con elevación automática, de manera también eléctrica, de la sección de los pies. 	<ul style="list-style-type: none"> • La sección de pies no se eleva de forma automática.

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES

A tenor del análisis realizado en el apartado anterior, en el que ninguna de las propuestas técnicas presentadas por los distintos licitadores cumplen las características mínimas exigidas, no se puede evaluar ninguna de las soluciones aportadas.

5. CONCLUSIONES

Las ofertas presentadas por las empresas licitadoras:

- DISPROSERCA, S.L.
- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.:
- LINET IBERIA, SL
- MEDICAL IBERICA, SA

no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Lo que se traslada a la mesa de contratación para su conocimiento y efectos oportunos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:17
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0eu4qmX1cHwJkTQPNBcFJBp8otefIJxB



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:22



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS ECONÓMICOS



Cofinanciado por la Unión Europea

EXPEDIENTE:

23/S/23/SU/CO/A/R03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. EXPEDIENTE COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 85% PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2021-2027.

LOTE III

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24

TABLA DE CONTENIDO

1. EMPRESAS OFERTANTES / OFERTAS	- 2 -
1.1 Los documentos estudiados correspondientes a cada oferta son los siguientes:.....	- 3 -
2. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES GENERALES Y DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS (apartado 15.2.2. del PCAP)	- 4 -
2.1 Oferta Técnica:	- 4 -
2.2. Criterios de adjudicación	- 4 -
2.3. Compromiso de entrega:.....	- 5 -
2.4 Compromiso de fabricación:.....	- 5 -
2.5. Compromiso mantenimiento elementos ofertados y repuestos	- 5 -
2.6. Condiciones de la garantía	- 5 -
3.7. Información sobre accesorios y fungibles	- 6 -
2.8. Cumplimiento de la normativa	- 6 -
2.9 Formación	- 7 -
2.10. Condición especial de ejecución.....	- 7 -
2.11. Subcontratación:	- 7 -
3. EVALUACIÓN TÉCNICA	- 8 -
3.1. ACJ, SAU	- 8 -
3.2. DISPROSERCA, SL.....	- 9 -
3.3. LINET IBERIA, SL	- 9 -
3.4. TÉCNICAS BIOFÍSICAS, SL.....	- 9 -
4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES.....	- 9 -
5. CONCLUSIONES	- 10 -

1. EMPRESAS OFERTANTES / OFERTAS

Se han analizado las siguientes ofertas y equipos correspondientes al Lote III:

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

- 2 -

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24

OFERTA	EQUIPO OFERTADO	MUESTRAS	IMAGEN
ACJ, S.A.U.	MARCA: NITROCARE MODELO: SD09	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
DISPROSERCA, S.L.	MARCA: Schröder MODELO: CYCLONE	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
LINET IBERIA, S.L.	MARCA: LINET MODELO: SPRINT 200	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	
TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.	MARCA: HILL-ROM MODELO: P8000	JUSTIFICANTE DE ENTREGA	

1.1 Los documentos estudiados correspondientes a cada oferta son los siguientes:

Tabla 1. Documentación presentada (67 documentos correspondientes a seis ofertas):

N.º	ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
1	Acreditación fabricante distribución - post-venta.pdf	Anexo Accesorios Fdo.pdf	Declaración fungibles y accesorios.pdf	3. DECLAR. COMPROM. ENTREGA - Firmado.pdf
2	Acreditaciones fabricante Lote 3.pdf	Anexo Compromiso Camas En Deposito Fdo.pdf	0 Anexo_I_Oferta_economica.pdf	4. DECLAR. COMPROM. FABRIC - Firmado.pdf
3	Anexo I. Oferta economica.pdf	Anexo Compromiso de Fabricación Fdo.pdf	2021 ISO_9001_LINET IBERIA.pdf	5. DECLAR. COMPROM. MANTENI - Firmado.pdf
4	ANEXO V Declaración relativa a la subcontratación.pdf	Anexo Compromiso Entrega Fdo.pdf	2021 ISO_14001_LINET IBERIA.pdf	6. CONDICIONES GARANTIA - Firmado.pdf
5	Anexo VI. Criterios de adjudicación.pdf	Anexo Compromiso Mantenimiento Equipos Ofertados Fdo.pdf	Anexo_V_Declaración_subcontratación.pdf	7. INFOR. ACCESORIOS Y FUNGIBLES - Firmado.pdf
6	Compromiso de fabricación.pdf	Anexo Condición Especial de Ejecución Fdo.pdf	Anexo_VI_Oferta_criterios_adjudicación.pdf	8. CUMPLIM. NORMATIVA - Firmado.pdf
7	Compromiso mantenimiento elementos ofertados.pdf	Anexo Condiciones Garantía Fdo.pdf	Camilla Sprint 200 - Declaración conformidad.pdf	9. FORMACION - Firmado.pdf
8	Condición especial de ejecución.pdf	Anexo I Oferta Económica Fdo.pdf	Compromiso formación.pdf	10. CONDIC. ESPEC. EJECUCION - Firmado.pdf
9	Condiciones de garantía.pdf	Anexo V Declaración Subcontratación Fdo.pdf	Condición especial de ejecución.pdf	AE1 Lote 3 Descripción_compressed - Firmado.pdf
10	Cumplimiento de condiciones generales. Compromiso de entrega.pdf	Anexo VI Oferta Criterios Adjudicación Fdo.pdf	Declaración compromiso de entrega.pdf	ANEXO I PROP. ECONOM - Firmado.pdf
11	Ficha técnica Lote 3.pdf	Cumplimiento Normativas.pdf	Declaración compromiso de fabricación.pdf	ANEXO V DECLAR. SUBCONTR. - Firmado.pdf


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



12	Formacion. Propuesta detallada.pdf	CYCLONE -Manual de Usuario.pdf	Declaracion compromiso mantenimiento elementos ofertados.pdf	ANEXO VI CRITER. ADJUDIC - Firmado.pdf
13	Listado de accesorios Lote 3.pdf	FICHA TECNICA PRODUCTOS OFERTADOS.pdf	Declaracion condiciones de la garantia.pdf	DECLAR. CATALOG. CAMILLA TRANSTAR LOTE 3 - Pag. catalogo.pdf
14	Manual de servicio Lote 3.pdf	PROPUESTA DETALLADA DE LA OFERTA FORMATIVA Fdo.pdf	1.Oferta tecnica Lote 3.pdf	DECLAR. CATALOG. CAMILLA TRANSTAR LOTE 3 - Pag. catalogo.pdf
15	Manual de uso Lote 1.pdf		2.Sprint 200 - Catalogo.pdf	Lote 1 y 3 PPT FICHAS TECNICAS - Firmado.pdf
16	Normativa Aplicable.pdf		3.Spring 200 Product data.pdf	Lote 3 Catalogo procedural-stretcher.pdf
17	Normativa Lote 3.pdf			Lote 3 stretcher-family-brochure-5en145308-02.pdf
18	Oferta tecnica Lote 3.pdf		5.Ficha técnica colchon Reactivo Spring 200.pdf	Lote 1 y 3 PPT FICHAS TECNICAS - Firmado.pdf

2. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES GENERALES Y DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS (apartado 15.2.2. del PCAP)

El documento correspondiente de la oferta, presentado por cada licitador, se identifica entre paréntesis según tabla 1 del apartado anterior.

2.1 Oferta Técnica:

Documentación que indique claramente el cumplimiento de cada una de las características técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con indicación de aquellas que superen los requerimientos mínimos, expresándolas en las mismas unidades utilizadas en el Pliego, con indicación de la norma de referencia para la medición. Deberá proporcionarse la máxima descripción, catálogos, hojas de datos técnicos (*product data*), e información que permita verificar el cumplimiento de dichas características y realizar una completa valoración de la oferta presentada. **Asimismo, se incluirá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación cualitativos.**

Los ofertantes podrán añadir a la información solicitada, cuanta información técnica, comercial o de operación y uso consideren conveniente para facilitar el conocimiento y evaluación de las características y prestaciones de los equipos ofertados, teniendo en cuenta que el contenido de toda la documentación incluida o adjunta a las ofertas formará parte de los compromisos contractuales y consecuentemente, de las obligaciones como contratista, en caso de resultar adjudicatarios.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (18, 11, 14 y 15)	Documento (13)	Documento (14,15,16 y 18)	Documento (14, 15,16,17 y 18)

2.2. Criterios de adjudicación

ANEXO VI de este Pliego debidamente cumplimentado.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

- 4 -

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24

Documento (5)	Documento (10)	Documento (6)	Documento (12)
---------------	----------------	---------------	----------------

2.3. Compromiso de entrega:

Compromisos del licitador para cumplir las condiciones establecidas para la entrega de los elementos, en los términos de plazos, lugares de entrega y montaje, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (10)	Documento (4)	Documento (10)	Documento (1)

2.4 Compromiso de fabricación:

Declaración responsable de que el equipamiento ofertado es de fabricación nueva y compromiso de que la fecha de fabricación del equipamiento a entregar, en ningún caso será anterior a 24 meses contados desde la fecha de entrega del material al Hospital, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (6)	Documento (3)	Documento (11)	Documento (2)

2.5. Compromiso mantenimiento elementos ofertados y repuestos

Compromiso del licitador de mantener los elementos ofertados disponibles en el mercado durante un período mínimo de cinco años y los componentes y repuestos, durante un período de 10 años, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (7) ^{1*}	Documento (5) ^{2*}	Documento (12) ^{3*}	Documento (3) ^{4*}

^{1*} ... los componentes y repuestos, durante un período de 10 años.

^{2*} ... servicio de repuestos contra cargo por 10 años.

^{3*} ... repuestos, durante un período de 10 año.

^{4*} ... componentes y repuestos, durante un período de 10 años.

2.6. Condiciones de la garantía

Plazos y condiciones de la garantía (incluyendo el alcance del mantenimiento preventivo y la propuesta del cronograma de ejecución del mismo), así como descripción de los recursos humanos y materiales de que disponen para la prestación del servicio de asistencia técnica de postventa y sus compromisos en materia de tiempo de respuesta técnica, tiempo de resolución, disponibilidad de repuestos, etc., de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
-------------	-------------------	--------------------	---------------------------

C/ Pérez de Rozas 5, 3ª Planta
38071 - S/C de Tenerife
Telf: 922 951 804 / 805

- 5 -

Avda. Juan XXIII, 17
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 118 949

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24


Documento (9) ^{1*}	Documento (7 y 8) ^{2*}	Documento (2 y 13) ^{3*}	Documento (4 y 10) ^{4*}
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

^{1*} 6 años (3 años mínimo + 3 años ampliación).

^{2*} La garantía ofrecida para los diferentes equipos ofertados es de 5 años, dos años más sobre el mínimo requerido en el Pliego.

^{3*} ... 36 + 60 = 96 meses de garantía total.

^{4*} ... (mínimo 36 meses + 60 meses de ampliación), Total 96 meses.

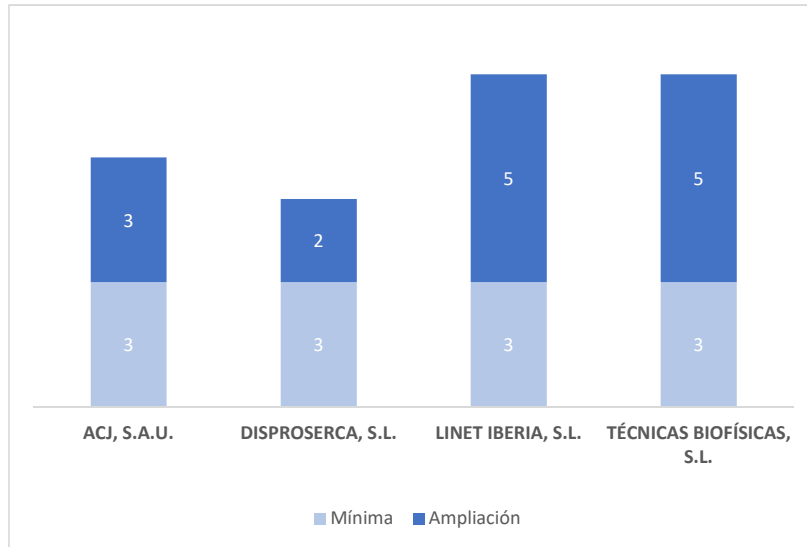

3.7. Información sobre accesorios y fungibles

Información complementaria referente al material fungible y accesorio asociados al equipamiento objeto de adquisición, de conformidad con lo establecido en la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (13)	Documento (1)	Documento (1)	Documento (5)

2.8. Cumplimiento de la normativa

Documentación acreditativa de que los equipos cumplen los requisitos legales y normativas vigentes, así como las normas de calidad superadas por los elementos a suministrar, de conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (16)	Documento (11)	Documento (7)	Documento (6)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24

2.9 Formación

Propuesta detallada del alcance, contenido, metodología y lugar de celebración de la formación a impartir en los centros hospitalarios de destino del equipamiento, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (12)	Documento (14)	Documento (8)	Documento (7)

2.10. Condición especial de ejecución

Declaración responsable del licitador por la que se compromete, en relación a la recogida de envases y embalajes que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, a responsabilizarse de una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato, que incluirá la retirada de los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado, de conformidad con lo establecido en la cláusula 25.4 del presente Pliego.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (8)	Documento (6)	Documento (9)	Documento (8)

2.11. Subcontratación:

Se ha de incluir en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 30 del presente pliego y cuyo modelo se adjunta al mismo como ANEXO.

ACJ, S.A.U.	DISPROSERCA, S.L.	LINET IBERIA, S.L.	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
Documento (4) ^{1*}	Documento (9) ^{2*}	Documento (5) ^{3*}	Documento (11) ^{4*}

^{1*} Que en la oferta presentada no se va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

^{2*} Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

^{3*} Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

^{4*} Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24

3. EVALUACIÓN TÉCNICA

A continuación se analiza el cumplimiento de las características establecidas como mínimas en las fichas técnicas del apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), para el **LOTE 3** del equipamiento del presente expediente (Camillas).

Los resultados de dicho análisis, ofrecen los incumplimientos a continuación señalados para cada una de las propuestas presentadas por cada licitador a través de la documentación técnica aportada así como de la inspección y comprobación con las muestras entregadas en cada uno de los centros hospitalarios de referencia exigidos:

3.1. ACJ, SAU

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

SUPERFICIE MÍNIMA PARA EL PACIENTE

EXIGIDO	OFERTADO
• Mínima superficie del paciente de 75 cm	• Superficie para el paciente de 65 cm de ancho.

RUEDAS

EXIGIDO	OFERTADO
• Accionamiento de las ruedas por doble pedal situado tanto en la cabecera como a los pies, con las funciones de frenado, movimiento libre y 5ª rueda	• La quinta rueda sólo se activa desde los laterales.
• Diámetro mínimo de 200 mm, carenadas.	• La quinta rueda es de 125 mm de diámetro

COLCHÓN

EXIGIDO	OFERTADO
• La superficie acolchada deberá estar realizada en poliuretano ignífugo y antiestático, de fácil limpieza y que permita la aplicación de productos desinfectantes hospitalarios. El espesor mínimo será de 100 mm	• El espesor del colchón es de 90 mm

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24

3.2. DISPROSERCA, SL

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

RUEDAS

EXIGIDO	OFERTADO
• Diámetro mínimo de 200 mm, carenadas.	• La quinta rueda es de 150 mm de diámetro

3.3. LINET IBERIA, SL

La propuesta presentada por esta empresa cumple los requisitos técnicos mínimos exigidos.

3.4. TÉCNICAS BIOFÍSICAS, SL

Se recogen -de manera detallada- los incumplimientos técnicos de la propuesta de la empresa

RUEDAS

EXIGIDO	OFERTADO
• Diámetro mínimo de 200 mm, carenadas.	• La quinta rueda es de 125 mm de diámetro

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES

A tenor del análisis realizado en el apartado anterior, a continuación se barema únicamente las ofertas admitidas, pues cumplen los requisitos mínimos exigidos.

La mejor relación calidad precio en la ejecución del contrato, se evalúa mediante la valoración de los siguientes criterios de adjudicación, con arreglo a lo descrito en el apartado 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación:

:

Criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes

LOTE 3.- CAMILLAS		Linnet Iberia,SL
CRITERIOS CUALITATIVOS		
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES	65 puntos	53
2.1 Mayor capacidad de carga por encima de los 200 kg exigidos.	13	13 495 (320 kg)
2.2 Menor altura mínima de la superficie del paciente por debajo de los 500 mm que se exigen.	12	0 500 mm

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24

LOTE 3.- CAMILLAS		Linet Iberia,SL
2.3 Menor peso del modelo de camilla en vacío incluyendo accesorios mínimos.	10	10 167 Kg
2.4 Sistema de frenado centralizado interno a las 4 ruedas mediante corona metálica y no plástica	9	9 SI
2.5 Con posibilidad de elegir entre seis colores diferentes o más en los cuatro protectores antigolpes de la base de la camilla para saber a qué zona hospitalaria pertenece la camilla	8	8 SI
2.6. El modelo de camilla dispone de empujadores escamoteables en la zona del piecero	8	8 SI
2.7. Ampliación del periodo de garantía	5	5 96 meses

5. CONCLUSIONES

Las ofertas presentadas por las empresas licitadoras:

- ACJ, SAU.
- DISPROSERCA, S.L.
- TECNICAS BIOFÍSICAS,S.L.

no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas; mientras que el licitador:

- LINET SL

Sí cumple con las características mínimas requeridas.

En cuanto a los criterios cualitativos, a excepción del criterio económico, la puntuación otorgada a la empresa que cumple los requisitos exigidos acorde al cuadro anterior asciende a cincuenta y tres (53) puntos.

Lo que se traslada a la mesa de contratación para su conocimiento y efectos oportunos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NELSON SUAREZ MARTIN - TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO
ALBERTO CREMADES DIAZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 18/09/2023 - 10:09:15
Fecha: 17/09/2023 - 16:15:42

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0ARnBeUNyPQ9_VOgaaJA6AVBPYH1mu27M



El presente documento ha sido descargado el 18/09/2023 - 10:15:24

ANEXO II

INFORME DE VALORACIÓN FINAL

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ELVIRA CARMEN GONZALEZ VALIDO - JEFE DE SECCION DE GESTION ECONOMICA
YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO

Fecha: 25/09/2023 - 08:36:28
Fecha: 22/09/2023 - 10:38:32

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0U7oBWGcx-vxsw9SReqizqKixr4xeOgX9



El presente documento ha sido descargado el 25/09/2023 - 08:36:43



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS ECONÓMICOS



Cofinanciado por la Unión Europea

INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE Nº 23/S/23/SU/CO/A/R03 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. Expediente cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027.

RELACIÓN DE EMPRESAS PRESENTADAS POR LOTE

LOTE 1.- CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 1

LICITADORES PRESENTADOS	VALORACIÓN DE LA OFERTA*
ACJ, S.A.U.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
DISPROSERCA, S.L.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
LINET IBERIA, S.L.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
MEDICAL IBÉRICA, S.A.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.	OFERTA ADMITIDA: cumple las características técnicas exigidas PPT

LOTE 2.- CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 2

LICITADORES PRESENTADOS	VALORACIÓN DE LA OFERTA*
DISPROSERCA, S.L.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
LINET IBERIA, S.L.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
MEDICAL IBÉRICA, S.A.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT

LOTE 3.- CAMILLAS

LICITADORES PRESENTADOS	VALORACIÓN DE LA OFERTA*
ACJ, S.A.U.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
DISPROSERCA, S.L.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT
LINET IBERIA, S.L.	OFERTA ADMITIDA: cumple las características técnicas exigidas PPT
TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.	OFERTA EXCLUIDA: incumple las características técnicas exigidas PPT

* Valoración establecida según informes técnicos de los Lotes n.º 1, n.º 2 y n.º 3 de 18 de septiembre de 2023

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES

En Las Palmas de Gran Canaria

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO

Fecha: 20/09/2023 - 10:47:12

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0kGZmskKvqdXIPRrc57f3cE2QsBpWNGZJ



El presente documento ha sido descargado el 20/09/2023 - 10:47:20

2. Ofertas Económicas



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS ECONÓMICOS



Cofinanciado por la Unión Europea

INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE Nº 23/S/23/SU/CO/A/R03 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. Expediente cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027.

OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITADORES ADMITIDOS

LOTE	UDS.	PRECIO OFERTA UD SIN IGIC	<u>PRECIO MÁX. LICITACIÓN UD SIN IGIC</u>	PRECIO TOTAL OFERTA SIN IGIC	IGIC %	IMPORTE IGIC	PRECIO OFERTA TOTAL C/IGIC	PLAZO GARANTÍA EN MESES
LINET IBERIA, S.L.								
3	281	3.198,00 €	3.400,00 €	898.638,00 €	3,00%	26.959,14 €	925.597,14 €	96
TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.								
1	1745	2.110,00 €	2.600,00 €	3.681.950,00 €	3,00%	110.458,50 €	3.792.408,50 €	96

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES

En Las Palmas de Gran Canaria

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO

Fecha: 20/09/2023 - 10:47:12

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0kGZmskKvqdXIPRrc57f3cE2QsBpWNGZJ



El presente documento ha sido descargado el 20/09/2023 - 10:47:20

3. Criterio1. Oferta Ec.

INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
EXPEDIENTE Nº 23/S/23/SU/CO/A/R03 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. Expediente cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027.
VALORACIÓN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1. OFERTA ECONÓMICA

LOTE 1.- CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 1	CRITERIO N.º 1. OFERTA ECONÓMICA		
LICITADORES ADMITIDOS	Precio C/IGIC	Puntos Criterio 1.1 Precio adquisición	Total Puntos Criterio 1. Oferta Ec.
TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.	3.792.408,50 €	35,00	35,00

LOTE 3.- CAMILLAS	CRITERIO N.º 1. OFERTA ECONÓMICA		
LICITADORES ADMITIDOS	Precio C/IGIC	Puntos Criterio 1.1 Precio adquisición	Total Puntos Criterio 1. Oferta Ec.
LINET IBERIA, S.L.	925.597,14 €	35,00	35,00

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES

En Las Palmas de Gran Canaria



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS ECONÓMICOS



Cofinanciado por la Unión Europea

INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE Nº 23/S/23/SU/CO/A/R03 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. Expediente cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027.

RESUMEN PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL LOTE N.º 1 CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 1

LOTE 1.- CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 1	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.
CRITERIOS ECONÓMICOS	PUNTOS
1.- OFERTA ECONÓMICA	35,00
1.1 Precio de adquisición	35,00
CRITERIOS CUALITATIVOS	PUNTOS
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES OFERTADAS*	54,00
2.1 Dotación de camas en depósito en el Hospital, durante el periodo de garantía (número de camas)	8,00
2.2 Restablecimiento, de manera eléctrica, de condiciones iniciales (cama en horizontal) presionando únicamente un botón de los mandos de la cama	6,00
2.3 Alarma de pedal de freno que indicará que la cama está conectada a la red eléctrica pero no está frenada	6,00
2.4 Luz de noche incluida en todas las camas con cambios de color.	6,00
2.5 Colchón encapsulado	6,00
2.6 Mayor número de movimientos programados (funciones automáticas preprogramadas activadas mediante desbloqueo)	6,00
2.7 Capacidad de acoplamiento a sistema de transporte mecánico.	6,00
2.8 Quinta rueda motorizada	0,00
2.9 Espacio ocupado en la activación (recorrido y situación finalista) de las barandillas inferior a 7 cm	5,00
2.10 Dispone, mediante accionamiento eléctrico, de sistema de lateralización del paciente	0,00
2.11 Ampliación del periodo de garantía	5,00
PUNTUACIÓN TOTAL	89,00

* Valoración establecida según informe técnico del Lote n.º 1 de 18 de septiembre de 2023

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES

En Las Palmas de Gran Canaria

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO

Fecha: 20/09/2023 - 10:47:12

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0kGZmskKvqdXIPRrc57f3cE2QsBpWNGZJ



El presente documento ha sido descargado el 20/09/2023 - 10:47:20



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS ECONÓMICOS



Cofinanciado por la Unión Europea

INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
EXPEDIENTE Nº 23/S/23/SU/CO/A/R03 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. Expediente cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027.
RESUMEN PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL LOTE N.º 3 CAMILLAS

LOTE 3.- CAMILLAS	LINET IBERIA, S.L.
CRITERIOS ECONÓMICOS	PUNTOS
1.- OFERTA ECONÓMICA	35,00
1.1 Precio de adquisición	35,00
CRITERIOS CUALITATIVOS	PUNTOS
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES OFERTADAS*	53,00
2.1 Mayor capacidad de carga por encima de los 200 kg exigidos.	13,00
2.2 Menor altura mínima de la superficie del paciente por debajo de los 500 mm que se exigen [entre 55 a 100 cm (±5cm)]	0,00
2.3 Menor peso del modelo de camilla en vacío incluyendo accesorios mínimos.	10,00
2.4 Sistema de frenado centralizado interno a las 4 ruedas mediante corona metálica y no plástica	9,00
2.5 Con posibilidad de elegir entre seis colores o más diferentes en los cuatro protectores antigolpes de la base de la camilla para saber a qué zona hospitalaria pertenece la camilla	8,00
2.6 El modelo de camilla dispone de empujadores escamoteables en la zona del piecero	8,00
2.7 Ampliación del periodo de garantía	5,00
PUNTUACIÓN TOTAL	88,00

* Valoración establecida según informe técnico del Lote n.º 3 de 18 de septiembre de 2023

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES

En Las Palmas de Gran Canaria

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO	Fecha: 20/09/2023 - 10:47:12
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0kGZmskKvqdXIPRrc57f3cE2QsBpWNGZJ	
El presente documento ha sido descargado el 20/09/2023 - 10:47:20	

6. Propuesta de adjudicación



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS ECONÓMICOS



Cofinanciado por la Unión Europea

INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
EXPEDIENTE Nº 23/S/23/SU/CO/A/R03 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS CLÍNICAS Y CAMILLAS CON DESTINO A DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. Expediente cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027.
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

LOTE	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN CRITERIO 1. OFERTA EC.	PUNTUACIÓN CRITERIO 2. PRESTACIONES	TOTAL PUNTUACIÓN CRITERIOS
LOTE N.º 1	CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 1	TÉCNICAS BIOFÍSICAS, S.L.	35,00	54,00	89,00
LOTE N.º 2	CAMAS HOSPITALARIAS TIPO 2	DESIERTO	-----	-----	-----
LOTE N.º 3	CAMILLAS	LINET IBERIA, S.L.	35,00	53,00	88,00

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES

En Las Palmas de Gran Canaria

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
YERAY JAIME TALAVERA MARTIN - TECNICA/O TITULAD.SUPERIOR JURIDICO	Fecha: 20/09/2023 - 10:47:12
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0kGZmskKvqdXIPRrc57f3cE2QsBpWNGZJ	 
El presente documento ha sido descargado el 20/09/2023 - 10:47:20	