

**ACTA Nº 3 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS SUJETOS A VALORACIÓN POSTERIOR (SOBRE 3) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA BOMBA VOLUMÉTRICA DE NUTRICIÓN ENTERAL, LINEAS DE INFUSIÓN PARA PERFUSORES DE JERINGA Y FILTROS DE 0,2µm. CON DESTINO A LOS CENTROS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (PA/08/2019)**

**Presidenta:**

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Antonia Quintana Cortijo  
Subdirectora de Compras y Logística  
del CGIPC.

**Secretario:**

D. Pedro Anguita Rubio  
Jefe de Servicio de la Subdirección  
de Compras y Logística.

**Vocales:**

D. Francisco Diez Manglano  
Letrado de la Diputación General de Aragón.

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Luz Oliva Antón  
Intervención Delegada en OO.AA.

D<sup>a</sup>. Pilar Martínez Navarro  
Técnico de Gestión de la Subdirección  
de Compras y Logística.

En Zaragoza, a las 9:00 horas del día 14 de noviembre de 2018, y en la Sala Miguel Servet (5<sup>a</sup> Planta) de la sede del Servicio Aragonés de Salud, situada en Plaza de la Convivencia, nº 2, se reúnen las personas al margen reseñadas, componentes de la Mesa de contratación constituida al efecto.

Los vocales en representación de los Servicios Jurídicos y de la Intervención fueron convocados a la sesión, mediante correo interno y con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, conteniendo la convocatoria el orden del día, según se establece en el *Art. 19.3.a) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*.

Los componentes de la Mesa manifiestan que no concurren en ellos ningún conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento, y se comprometen a poner en conocimiento del órgano de contratación, de forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación o en la fase de ejecución.

La sesión tiene como objeto la apertura de la documentación relativa a los criterios sujetos a valoración posterior (Sobre 3) ) y, tras la valoración por la Mesa de contratación de las ofertas recibidas, la emisión de propuesta de adjudicación por el órgano de contratación del expediente tramitado por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación (PA/08/2019), cuyo objeto es la contratación del suministro de equipos para bomba volumétrica de nutrición enteral, líneas de infusión para perfusores de jeringa y filtros de 0,2 µm con destino a los centros del Servicio Aragonés de Salud.

La presidenta de la Mesa procede a dar lectura del acta nº 2, aprobándose por los miembros de la Mesa en todos sus extremos.

La Mesa de contratación procede a efectuar la **Valoración de los criterios sujetos a valoración previa**, en base al informe suscrito por Natalia Casanova Cartié, enfermera de la Subdirección de Compras y Logística encargada de coordinar a los Responsables de materiales de los Sectores en su elaboración, asumiendo así tanto las puntuaciones otorgadas como las motivaciones que sustentan dichas puntuaciones. El citado informe se adjunta a la presente Acta, formando parte inseparable de la misma.

La Presidencia inicia la sesión pública dando la bienvenida a los representantes de las empresas que asisten a la sesión, tomándose nota de los datos de los mismos:

<b>Empresas licitadoras</b>	<b>Representantes</b>
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	D. Jorge Llorente
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	D. José Ramón Berna y D <sup>a</sup> . Eva Viilloro
ICU MEDICAL, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	D <sup>a</sup> . Nieves Carnicero
LABORATORIOS CAIR, S.L.U.	D <sup>a</sup> . Maite Moreno

A continuación, se procede a notificar las puntuaciones otorgadas a las proposiciones presentadas por las empresas licitadoras, de acuerdo con los "Criterios sujetos a valoración previa" (Sobre 2) establecidos en el Anexo XI del Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), detallando las partidas que han quedado excluidas y por los motivos que igualmente se expresan:

- a) Proposiciones excluidas, en las partidas que se indican, al no haber superado el umbral mínimo de 35 puntos:

<b>Empresas licitadoras</b>	<b>Lotes y partidas</b>
LABORATORIOS CAIR, S.L.U.	Lote 3 (Partida 4)
PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 3 (Partidas 4 y 5)

- b) Proposiciones excluidas, en las partidas que se indican, por no ajustarse al Pliego de prescripciones técnicas:

<b>Empresas licitadoras</b>	<b>Lotes y partidas</b>
ABBOTT LABORATORIES, S.L.	Lote 1 (Partidas 1 y 2)
BECTON DICKINSON, S.A.	Lote 3 (Partida 6)
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	Lote 1 (Partidas 1 y 2)
ICU MEDICAL, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 2 (Partida 3)
PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 2 (Partida 3)
VYGON, S.A.U.	Lote 1 (Part. 1 y 2) y Lote 2 (Part.3)

Las proposiciones de las empresas ABBOTT LABORATORIES, S.L., CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L., ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L., LABORATORIOS CAIR, S.L.U., PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L. y VYGON, S.A.U., quedan excluidas en la totalidad de las ofertas a las que licitan por los motivos que se indican en los apartados anteriores.

El acuerdo de exclusión se notificará a las empresas afectadas mediante correo con acuse de recibo, publicándose simultáneamente en el Perfil de contratante, con expresión de las razones por las que no se haya admitido su oferta, atendiendo a lo establecido en el *Art. 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*.


El Secretario muestra los sobres número 3 "Criterios sujetos a valoración posterior" a los asistentes, a efectos de que comprueben que los mismos se encuentran en las mismas condiciones que se recibieron, desistiendo a dicha comprobación. A continuación, se realiza la apertura de los mismos, dando lectura de las proposiciones.

La Presidenta da las gracias a los asistentes, dando por concluida la sesión pública. A continuación, la Mesa de contratación procede a la **Valoración global de las proposiciones presentadas**, documento que se adjunta a esta Acta formando parte inseparable de la misma, según se establece en los artículos 145 y 326.1 de la LCSP.

Finalmente, la Mesa de contratación, una vez valoradas y clasificadas las ofertas, acuerda efectuar al órgano de contratación **Propuesta de adjudicación**, que se adjunta a este Acta formando parte inseparable de la misma, según se establece en el Art. 157 del LCSP.


Y sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9:15 horas en el lugar y fecha al principio señalado, de lo que como Secretario doy fe.

La Presidenta,

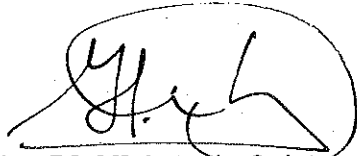


Fdo.: D.ª. M.ª Antonia Quintana Cortijo

El Secretario,

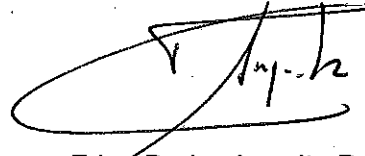

Fdo.: Pedro Anguita Rubio

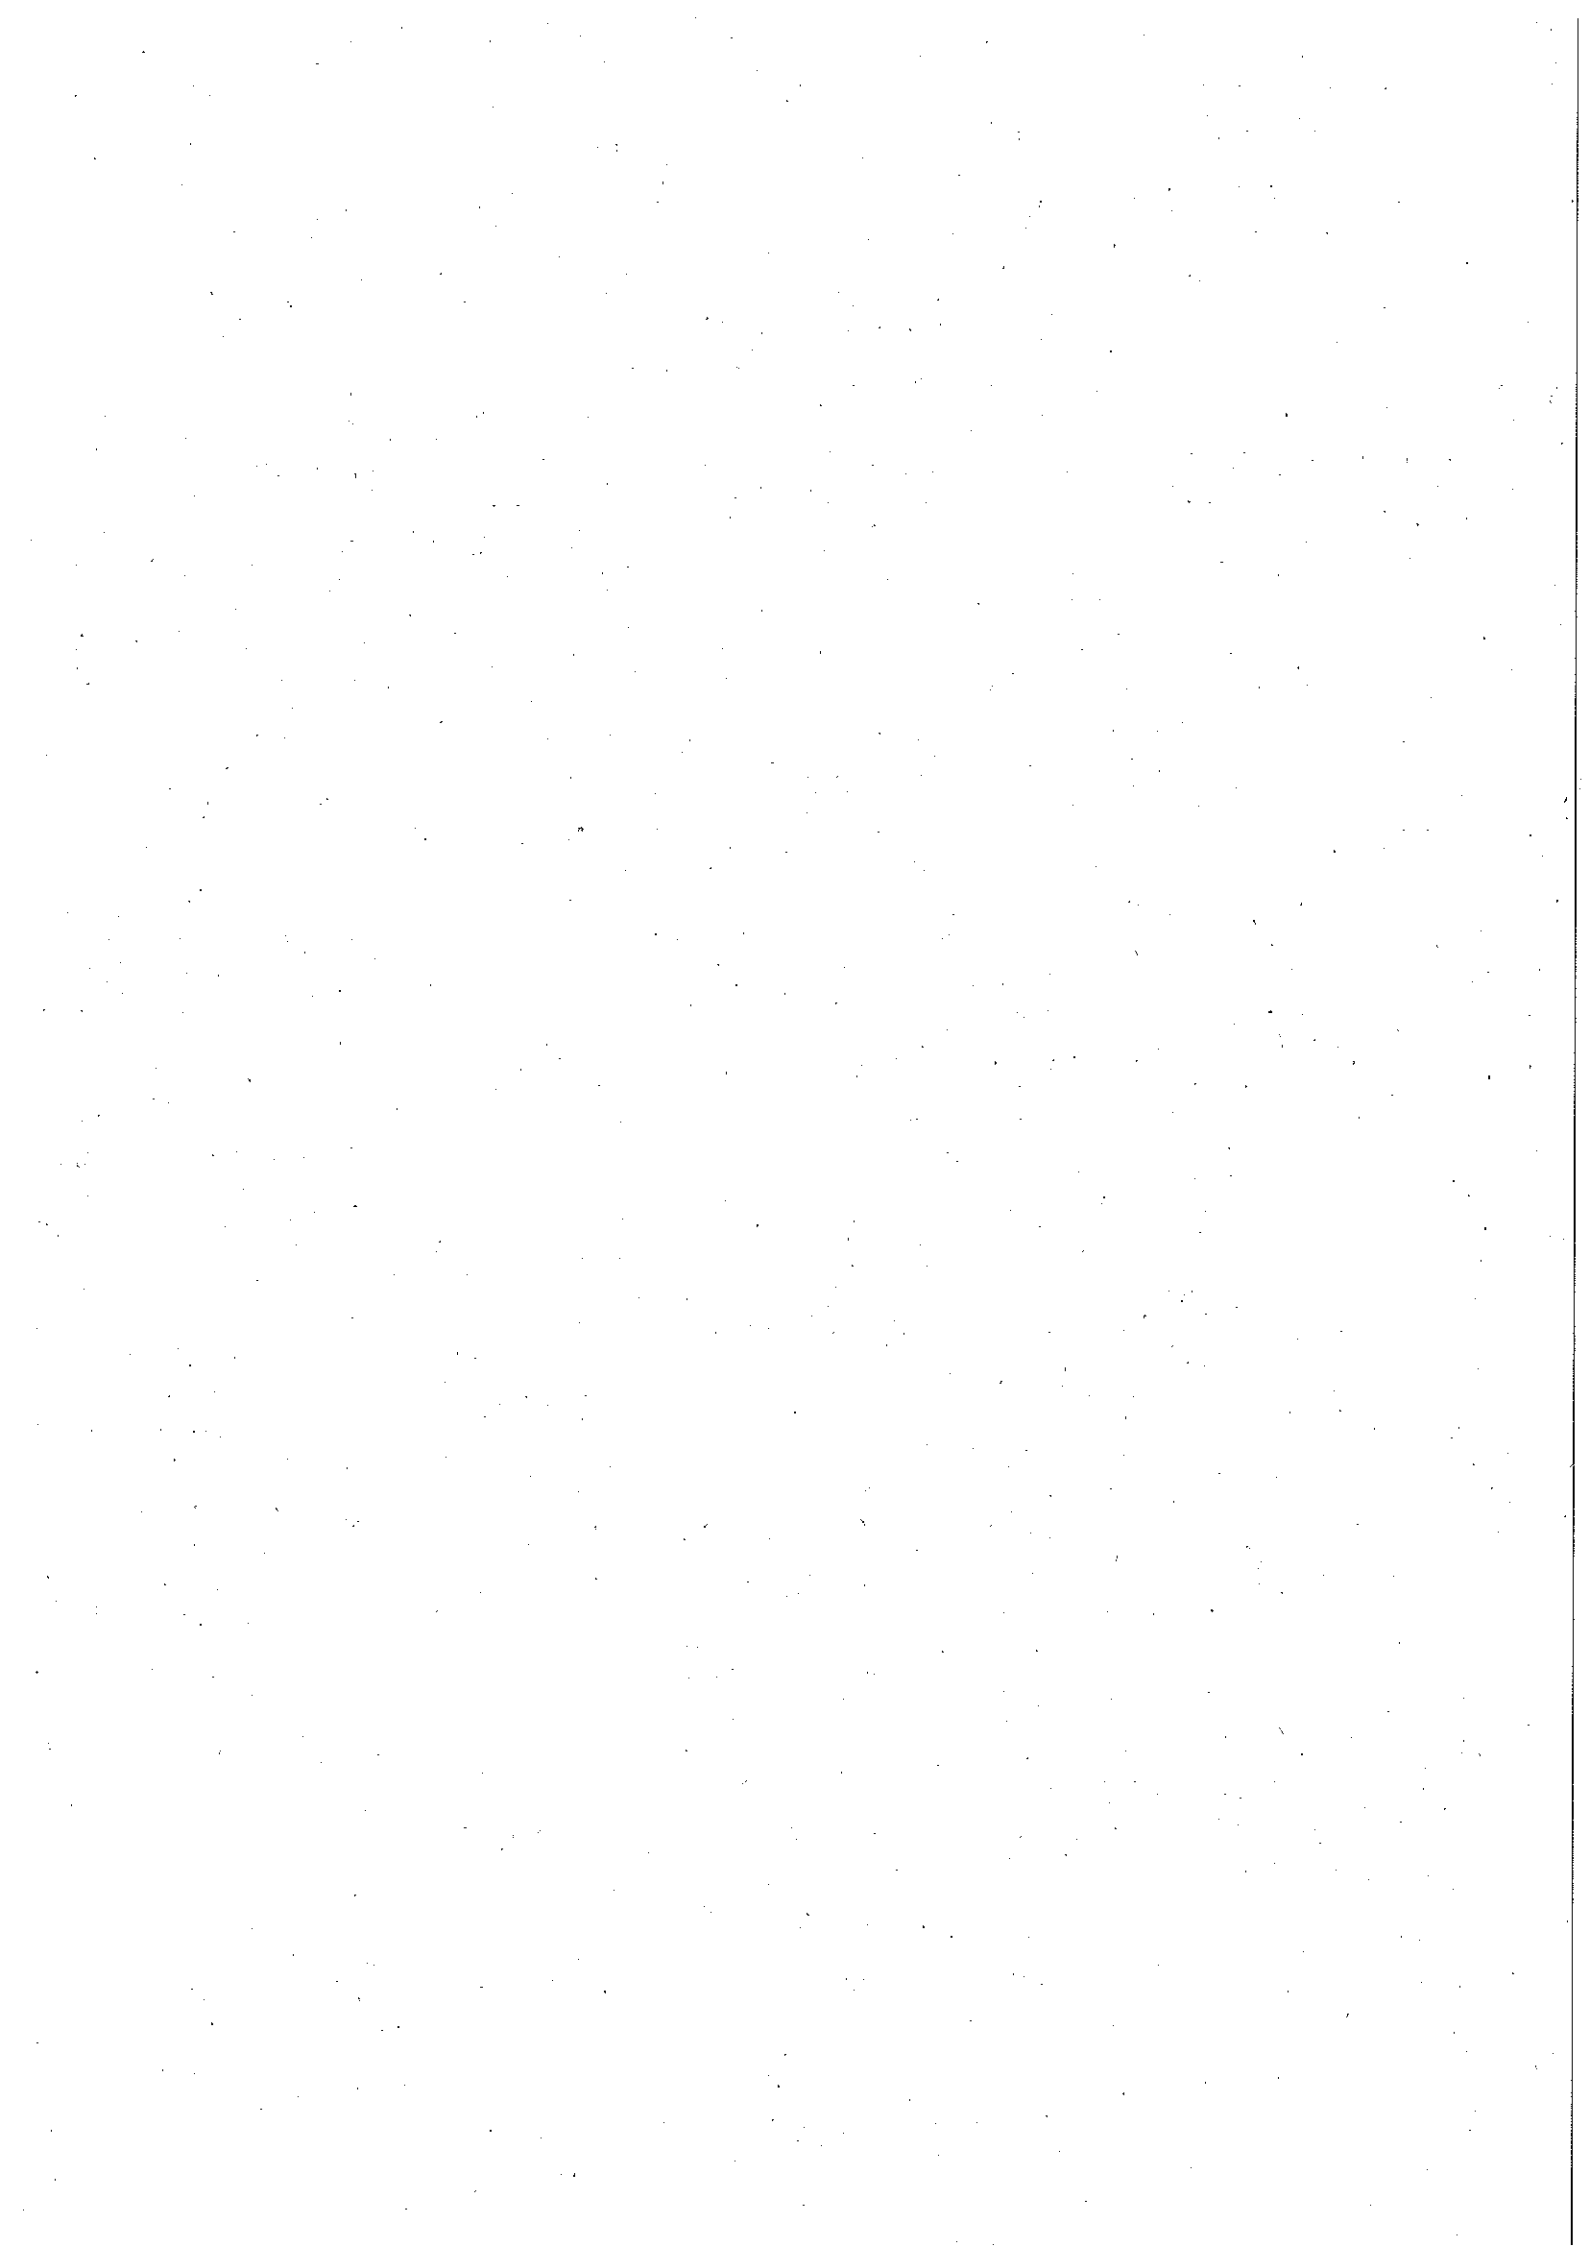

Informe técnico sobre los criterios sujetos a valoración previa establecidos en el PCAP del PA/08/2019

ZPIE: 1118001877 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN PARA BOMBA

Total

49

9

20

20

Punt. Max:  
Punt. Min:

10

10

4,5

35

Lote 1 (cerrado): Nutrición enteral por bomba volumétrica

Lote	Part.	Material	Descripción	Nombre	Marca	Modelo	Referencia	MANEJABILIDAD/CONFORTABILIDAD	Motivo	SEGURIDAD	Motivo	APERTURA DEL ENVASE	Motivo	Puntuación Total	Comentarios
1	1	90004190	EQUIPO NUTRICION ENTERAL C/BOLSA 500ML MINIMO COMPATIBLE C/BOMBA, DE PVC O EQUIV. CONECTOR ENPLUS Y UNIVERSAL P/ENVASES DE NUTRICION, PUERTO ENFIT EN LINEA. CONEXION ENFIT. ADAPTADORES DE TRANSICION. CODIGO COLOR. TRANSPARENTE. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	ABBOTT LABORATORIES	TOP-FILL FREEGO 1.5L ENFIT S81	S810								
1	2	90004190	EQUIPO DE NUTRICION ENTERAL COMPATIBLE C/BOMBA, DE PVC O EQUIV. CONECTOR ENPLUS Y CONECTOR UNIVERSAL PARA ENVASES DE NUTRICION, PUERTO ENFIT EN LINEA. CONEXION ENFIT. ADAPTADORES DE TRANSICION. CODIGO DE COLOR. TRANSPARENTE. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	ABBOTT LABORATORIES	SET FREEGO UNIVERSAL ENFIT S79	S795							E	No se ajusta al PPT: No presenta adaptadores de transición
1	1	90004190	EQUIPO NUTRICION ENTERAL C/BOLSA 500ML MINIMO COMPATIBLE C/BOMBA, DE PVC O EQUIV. CONECTOR ENPLUS Y UNIVERSAL P/ENVASES DE NUTRICION, PUERTO ENFIT EN LINEA. CONEXION ENFIT. ADAPTADORES DE TRANSICION. CODIGO COLOR. TRANSPARENTE. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	AMIKA PUMP SET BAG, ENFIT UNIV	AMIKA PUMP SET BAG, ENFIT UNIV	7751908		Excelente manejabilidad de los equipos y la bomba.	20	Los equipos y la bomba garantizan un uso seguro	9	La apertura del envase garantiza la esterilidad del contenido	49	
1	2	90004190	EQUIPO DE NUTRICION ENTERAL COMPATIBLE C/BOMBA, DE PVC O EQUIV. CONECTOR ENPLUS Y CONECTOR UNIVERSAL PARA ENVASES DE NUTRICION, PUERTO ENFIT EN LINEA. CONEXION ENFIT. ADAPTADORES DE TRANSICION. CODIGO DE COLOR. TRANSPARENTE. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	AMIKA PUMP SET VARIOLINE, ENFI	AMIKA PUMP SET VARIOLINE, ENFI	7751909								
1	1	90004190	EQUIPO NUTRICION ENTERAL C/BOLSA 500ML MINIMO COMPATIBLE C/BOMBA, DE PVC O EQUIV. CONECTOR ENPLUS Y UNIVERSAL P/ENVASES DE NUTRICION, PUERTO ENFIT EN LINEA. CONEXION ENFIT. ADAPTADORES DE TRANSICION. CODIGO COLOR. TRANSPARENTE. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	YVGON, S.A.	YVGON	EQUIPO DE NUTRICION ENTERAL PA	OVENP1P14S								No se ajusta al PPT: El material ofertado en la partida 2 no presenta conector universal
1	2	90004190	EQUIPO DE NUTRICION ENTERAL COMPATIBLE C/BOMBA, DE PVC O EQUIV. CONECTOR ENPLUS Y CONECTOR UNIVERSAL PARA ENVASES DE NUTRICION, PUERTO ENFIT EN LINEA. CONEXION ENFIT. ADAPTADORES DE TRANSICION. CODIGO DE COLOR. TRANSPARENTE. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	YVGON, S.A.	YVGON	EQUIPO DE NUTRICION ENTERAL PA	OVENEP14S								

**Informe técnico sobre los criterios sujetos a valoración previa establecidos en el PCAP del PAI08/2019**


ZPIE: 1148001877      SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN PARA BOMBA

Lote 1 (cerrado): Nutrición enteral por bomba volumétrica

Lote	Part.	Material	Descripción	Nombre	Marca	Modelo	Referencia	MANEJABILIDAD /CONFORTABILIDAD		SEGURIDAD		APERTURA DEL ENVASE		Puntuación Total	Comentarios
								Punt. Max:	Punt. Mín:	Motivo	Motivo	Motivo	Motivo		
1	1	90004191	EQUIPO NUTRICION ENTERAL C/BOLSA 500ML MINIMO COMPATIBLE C/BOMBA DE PVC O EQUIV. CONECTOR ENPLUS Y UNIVERSAL P/ENVASES DE NUTRICION, PUERTO ENFIT EN LINEA, CONEXION ENFIT, ADAPTADORES DE TRANSICION, CODIGO DE Y DEHP ESTERIL.	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	CARDINAL HEALTH	KANGAROO	777084	20	10	20	10	9	4,5	49	No se ajusta al PPT: No presenta adaptadores de transición
1	2	90004190	EQUIPO DE NUTRICION ENTERAL COMPATIBLE C/BOMBA, DE PVC O EQUIV. C/CONECTOR ENPLUS Y CONECTOR UNIVERSAL PARA ENVASES DE NUTRICION, PUERTO ENFIT EN LINEA, CONEXION ENFIT, ADAPTADORES DE TRANSICION, CODIGO DE COLOR, TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX Y DEHP ESTERIL.		CARDINAL HEALTH	KANGAROO	777403							35	
								<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>35</b>					

Todas las proposiciones que no superen el umbral mínimo de 35 puntos establecido en el PCAP quedan excluidas de la licitación. Igualmente quedan excluidas las proposiciones que en alguno de los criterios la valoración obtenida sea inferior a la mitad de los puntos establecidos para la misma. Las proposiciones que no se ajustan al Pliego de prescripciones técnicas, quedarán excluidas de la licitación y se indicarán con E.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2018

Enfermera de la Subdirección de  
 Compras y Logística  
  
 Fdo.: Natalia Casanova Carrié

Informe técnico sobre los criterios sujetos a valoración previa establecidos en el PCAP del PA/08/2019


ZPIE: 1118001877 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN PARA BOMBA

Lote 2: Filtros de 0,2 µm con extensión

Lote	Part.	Material	Descripción	Nombre	Marca	Modelo	Referencia	MANEJABILIDAD	Motivo	SEGURIDAD	Motivo	APERTURA DEL ENVASE	Motivo	Puntuación Total	Comentarios			
																Punt. Max:	20	20
														Punt. Min:	10	10	4,5	35
2	3	4364	FILTRO PARA SOLUCIÓN INTRAVENOSA DE 0,2µM. MEMBRANA DE FILTRACION DE NYLON O EQUIV.DE BAJA AFINIDAD A PROTEINAS CON EXTENSION DE BAJA ABSORCION, TRANSPARENTE. RESISTENTE A PRESIONES MINIMO DE 4 BAR. CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	VYGON, S.A.	VYGON	FILTRO ANTIBACTERIAN O PLANO 0,	808,22							E	No se ajusta al PPT: No lleva extensión			
2	3	4364	FILTRO PARA SOLUCIÓN INTRAVENOSA DE 0,2µM. MEMBRANA DE FILTRACION DE NYLON O EQUIV.DE BAJA AFINIDAD A PROTEINAS CON EXTENSION DE BAJA ABSORCION, TRANSPARENTE. RESISTENTE A PRESIONES MINIMO DE 4 BAR. CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	PMH	309,0484							E	No se ajusta al PPT: No resiste presiones de 4 bares y la extensión no es de baja absorción			
2	3	4364	FILTRO PARA SOLUCIÓN INTRAVENOSA DE 0,2µM. MEMBRANA DE FILTRACION DE NYLON O EQUIV.DE BAJA AFINIDAD A PROTEINAS CON EXTENSION DE BAJA ABSORCION, TRANSPARENTE. RESISTENTE A PRESIONES MINIMO DE 4 BAR. CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	ICU MEDICAL, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	ICU MEDICAL	EXT. FILTRO 0,22 ? FOTOPROTECT	12200							E	No se ajusta al PPT: No resiste presiones de 4 bares			

Todas las proposiciones que no superen el umbral mínimo de 35 puntos establecido en el PCAP quedan excluidas de la licitación. Igualmente quedan excluidas las proposiciones que en alguno de los criterios la valoración obtenida sea inferior a la mitad de los puntos establecidos para la misma. Las proposiciones que no se ajustan al Pliego de prescripciones técnicas, quedarán excluidas de la licitación y se indicarán con E.

Enfermera de la Subdirección de Compras y Logística

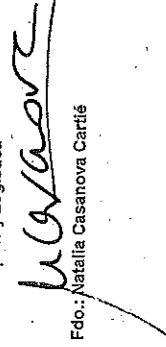

Zaragoza, 9 de noviembre de 2018

Fdo.: Natalia Casanova Cartés

Informe técnico sobre los criterios sujetos a valoración previa establecidos en el PCAP del PA/08/2019

ZPIE: 1118001877 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN PARA BOMBA

Lote 3: Líneas de infusión IV para inyectores

Punt. Max: 20 Punt. Min: 10 Total 49

Lote	Part.	Material	Descripción	Nombre	Marca	Modelo	Referencia		Motivo		Motivo		Motivo		Motivo	Puntuación Total	Comentarios
								Punt. Max: 20								Total 49	
								Punt. Min: 10								35	
3	4	23911	LÍNEA DE INFUSION INTRAVENOSA PARA BOMBA DE JERINGA O INYECTOR, RESISTENTE A PRESION MINIMO DE 20BAR. DE 150CM. TRANSPARENTE. CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	BECTON DICKINSON, S.A.	BD	ALARGADERA PRESION MEDIA	DH-150	20	Excelente manejabilidad de la línea	20	La línea garantiza un uso seguro	9	La apertura del envase garantiza la esterilidad del contenido	49			
3	4	23911	LÍNEA DE INFUSION INTRAVENOSA PARA BOMBA DE JERINGA O INYECTOR, RESISTENTE A PRESION MINIMO DE 20BAR. DE 150CM. TRANSPARENTE. CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	PMH	311.0895	5	El pequeño calibre interno de la línea no permite flujos adecuados en la realización de AngioTAC Coronario	20	La línea garantiza un uso seguro	9	La apertura del envase garantiza la esterilidad del contenido	34			
3	4	23911	LÍNEA DE INFUSION INTRAVENOSA PARA BOMBA DE JERINGA O INYECTOR, RESISTENTE A PRESION MINIMO DE 20BAR. DE 150CM. TRANSPARENTE. CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	CAIR	PRESICATH	PN3215S	5	El pequeño calibre interno de la línea no permite flujos adecuados en la realización de AngioTAC Coronario	20	La línea garantiza un uso seguro	9	La apertura del envase garantiza la esterilidad del contenido	34			
3	4	23911	LÍNEA DE INFUSION INTRAVENOSA PARA BOMBA DE JERINGA O INYECTOR, RESISTENTE A PRESION MINIMO DE 20BAR. DE 150CM. TRANSPARENTE. CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE LATEX. ESTERIL.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	SEDAT	ALGAFLEX	S0163PL	20	Excelente manejabilidad de la línea	20	La línea garantiza un uso seguro	9	La apertura del envase garantiza la esterilidad del contenido	49			
3	5	12048	LÍNEA DE INFUSION INTRAVENOSA PARA BOMBA DE JERINGA O INYECTOR, RESISTENTE A PRESION MINIMO DE 50CM. DE L. TRANSPARENTE. CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	BECTON DICKINSON, S.A.	BD	ALARGADERA PRESION MEDIA	DH-50	20	Excelente manejabilidad de la línea	20	La línea garantiza un uso seguro	9	La apertura del envase garantiza la esterilidad del contenido	49			



Informe técnico sobre los criterios sujetos a valoración previa establecidos en el PCAP del PA/08/2019

ZPIE: 1118001877 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN PARA BOMBA

Punt. Max: 20 Punt. Min: 10 Total 49

Lote 3: Líneas de infusión IV para inyectores

Lote	Part.	Material	Descripción.	Nombre	Marca	Modelo	Referencia	MANEJABILIDAD	Motivo	SEGURIDAD	Motivo	APERTURA DEL ENVASE	Motivo	Puntuación Total	Comentarios
3	5	12048	LÍNEA DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA BOMBA DE JERINGA O INYECTOR, RESISTENTE A PRESIÓN MÍNIMO DE 20BAR. DE 50CM DE L. TRANSPARENTE. CONEXIONES LUER-LOCK LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PMH	PMH	311.1214	5	El pequeño calibre interno de la línea no permite flujos adecuados en la realización de Angiotac Coronario	20	La línea garantiza un uso seguro	9	La apertura del envase garantiza la esterilidad del contenido	34	
3	6	1703	LÍNEA DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA BOMBA DE JERINGA O INYECTOR DE BAJA ABSORCIÓN. RESISTENTE A PRESIÓN MÍNIMO DE 68BAR. DE 100CM. MALLADA, TRANSPARENTE. CONEXIÓN LUER-LOCK METALICA. LIBRE DE LATEX Y DEHP. ESTERIL.	BECTON DICKINSON, S.A.	BD	ALARGADERA DE ALTA PRESIÓN	VPH-120							E	No se ajusta al PPT: Línea de 120 cms y la conexión luér-lock no es metálica


Todas las proposiciones que no superen el umbral mínimo de 85 puntos establecido en el PCAP quedan excluidas de la licitación. Igualmente quedan excluidas las proposiciones que en alguno de los criterios la valoración obtenida sea inferior a la mitad de los puntos establecidos para la misma. Las proposiciones que no se ajustan al Pliego de prescripciones técnicas, quedarán excluidas de la licitación y se indicarán con E.

Enfermera de la Subdirección de Compras y Logística

*Natalia Casanova Cartés*

Zaragoza, 9 de noviembre de 2018

Fdo.: Natalia Casanova Cartés

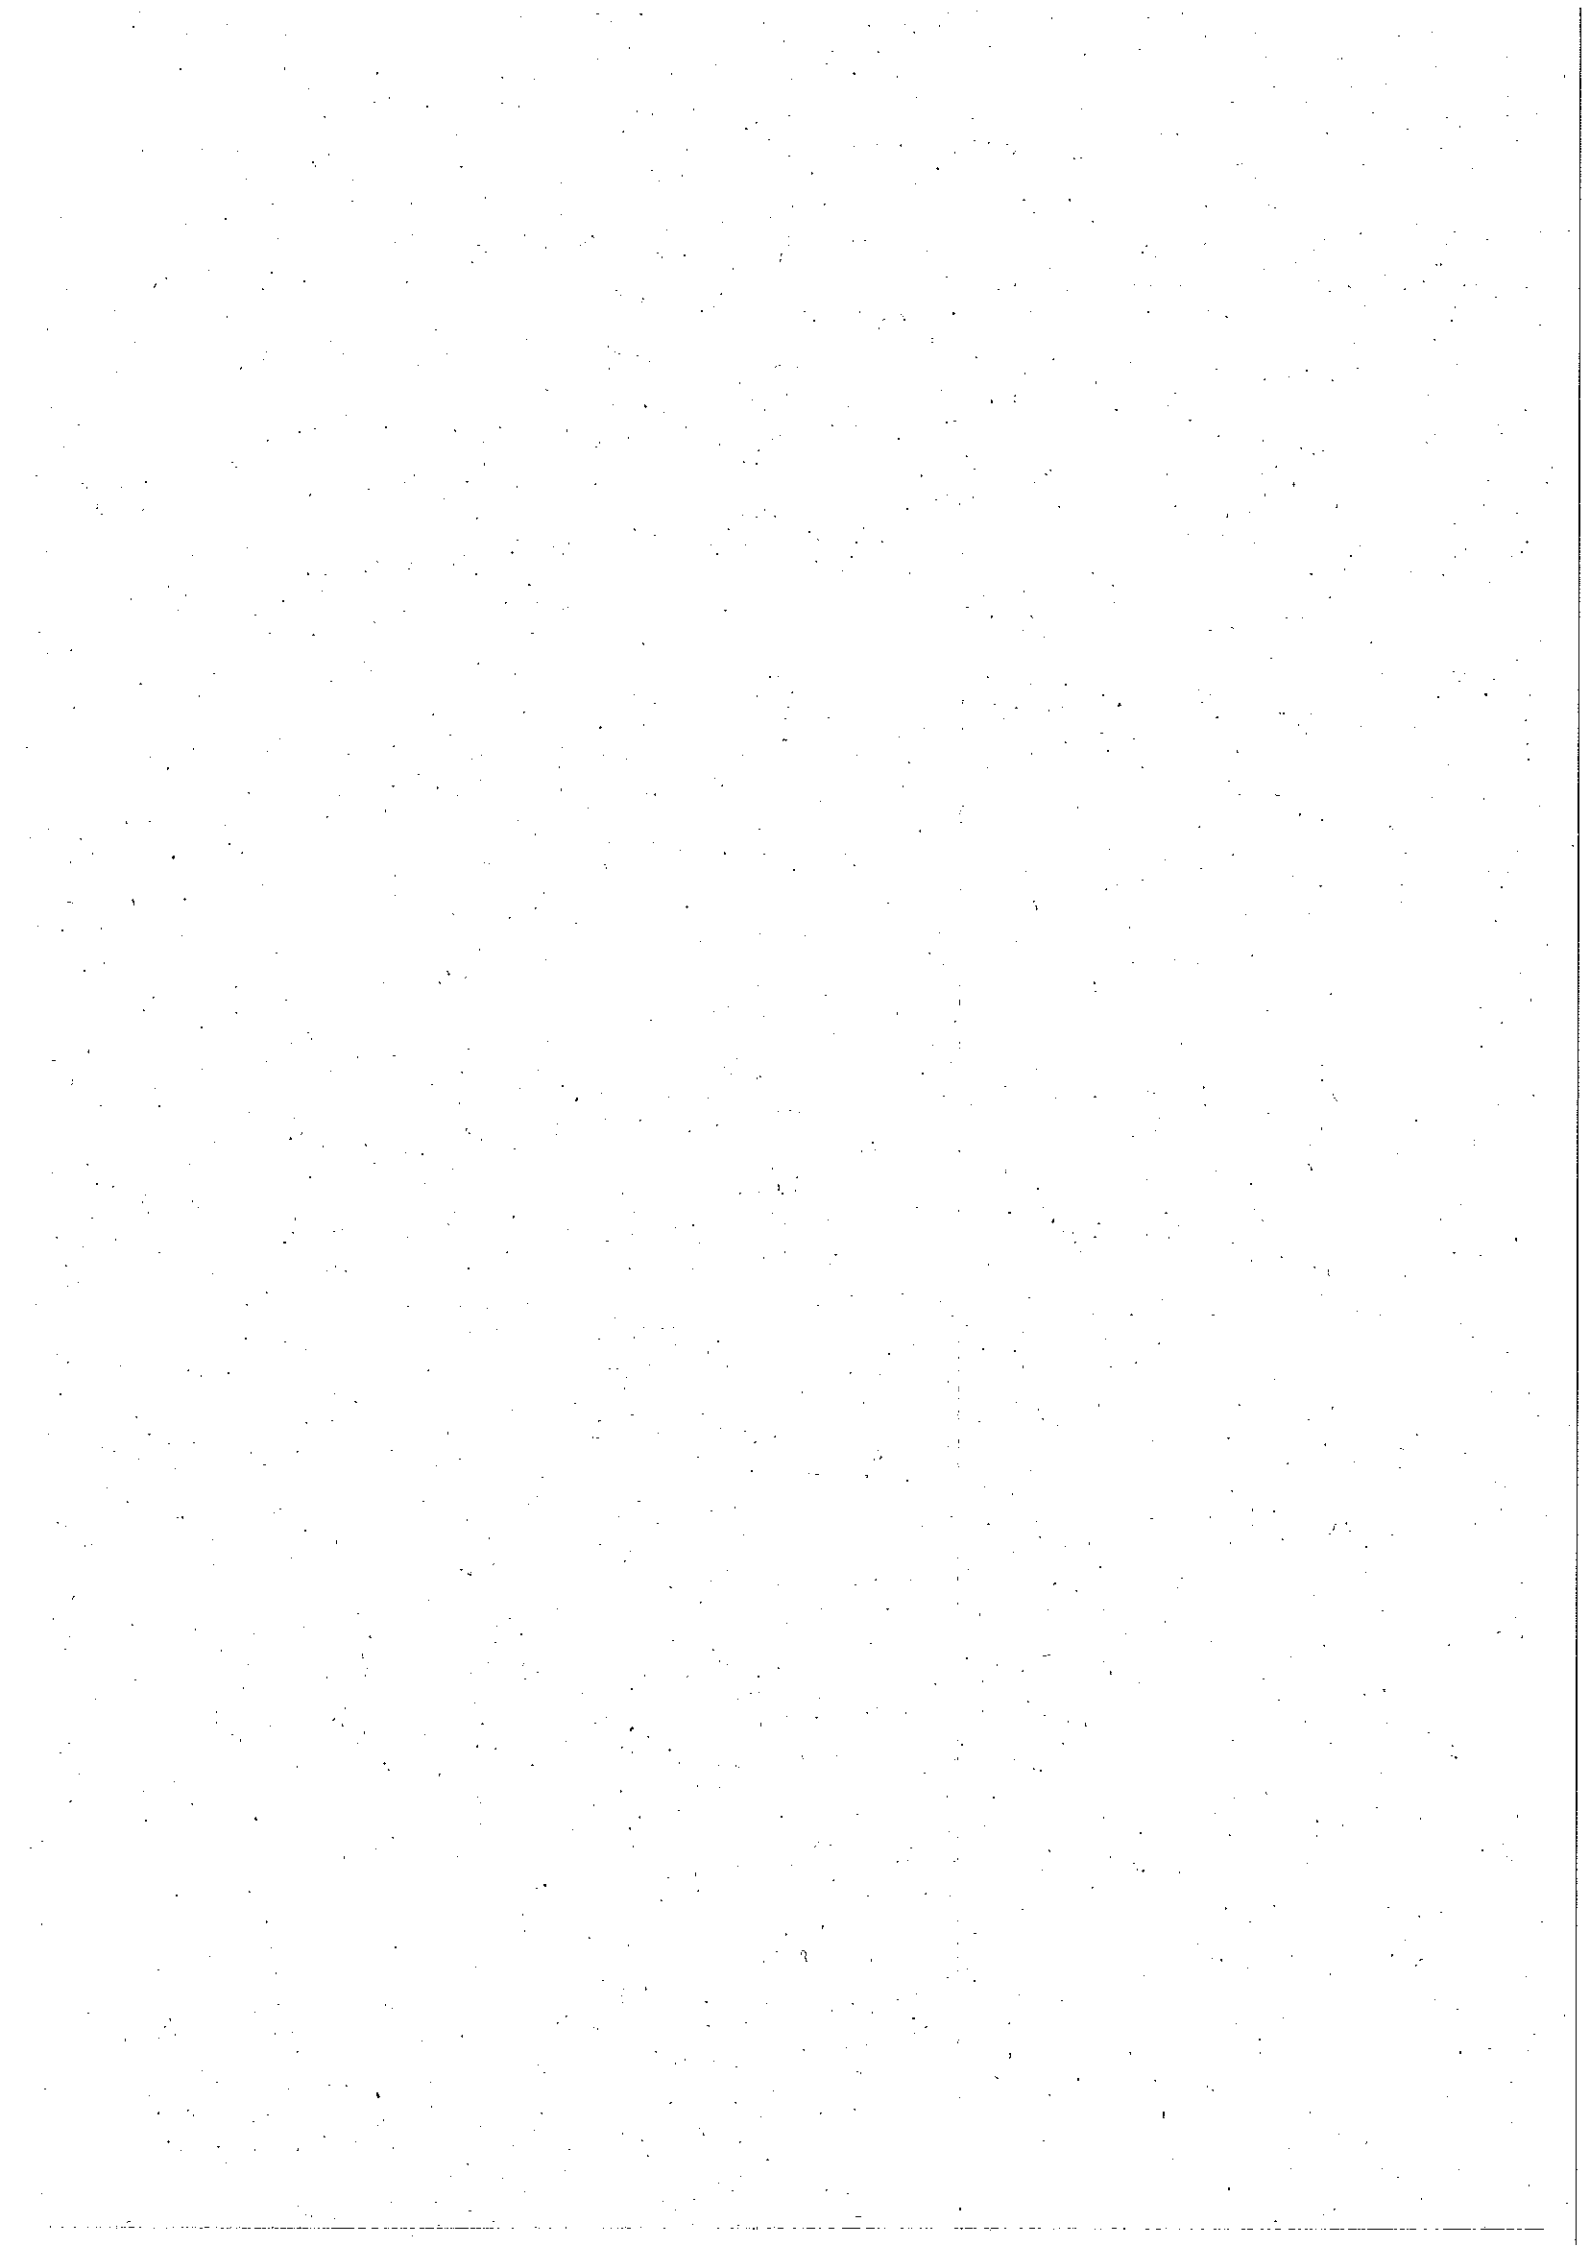


Valoración global efectuada por la Mesa de Contratación de las proposiciones recibidas en el expediente PA/08/2019

ZPIE: 1118001877 Sum. equipos p/ bomba volumétrica de nutrición enteral, líneas de infusión p/ perfusores de jeringa y filtros de 0,2 µm.

Lote 1 (cerrado): Nutrición enteral por bomba volumétrica


Lote	Part.	Material	Descripción	Licitador	Marca	Referencia	Puntuación Sobre 2	Precio Licitación SIVA	Precio Licitador SIVA	1. PRECIO (51,00 PT)	Puntuación Total
1	1	90004191	EQUIPO NUTRICION ENTERAL C/BOLSA P/BOMBA	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	AMIKA PUMP SET BAG, ENFIT UNIV	7751908	49,00	3,041322	3,00	5,78	54,78
1	2	90004190	EQUIPO NUTRICION ENTERAL POR BOMBA	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	AMIKA PUMP SET VARIOLINE, ENFI	7751909	49,00	3,136364	3,00	18,48	67,48

El Secretario




Fdo.: Pedro Anguita Rubio

La Presidenta

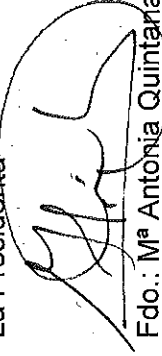

Fdo.: Mª Antonia Quintana Cortijo

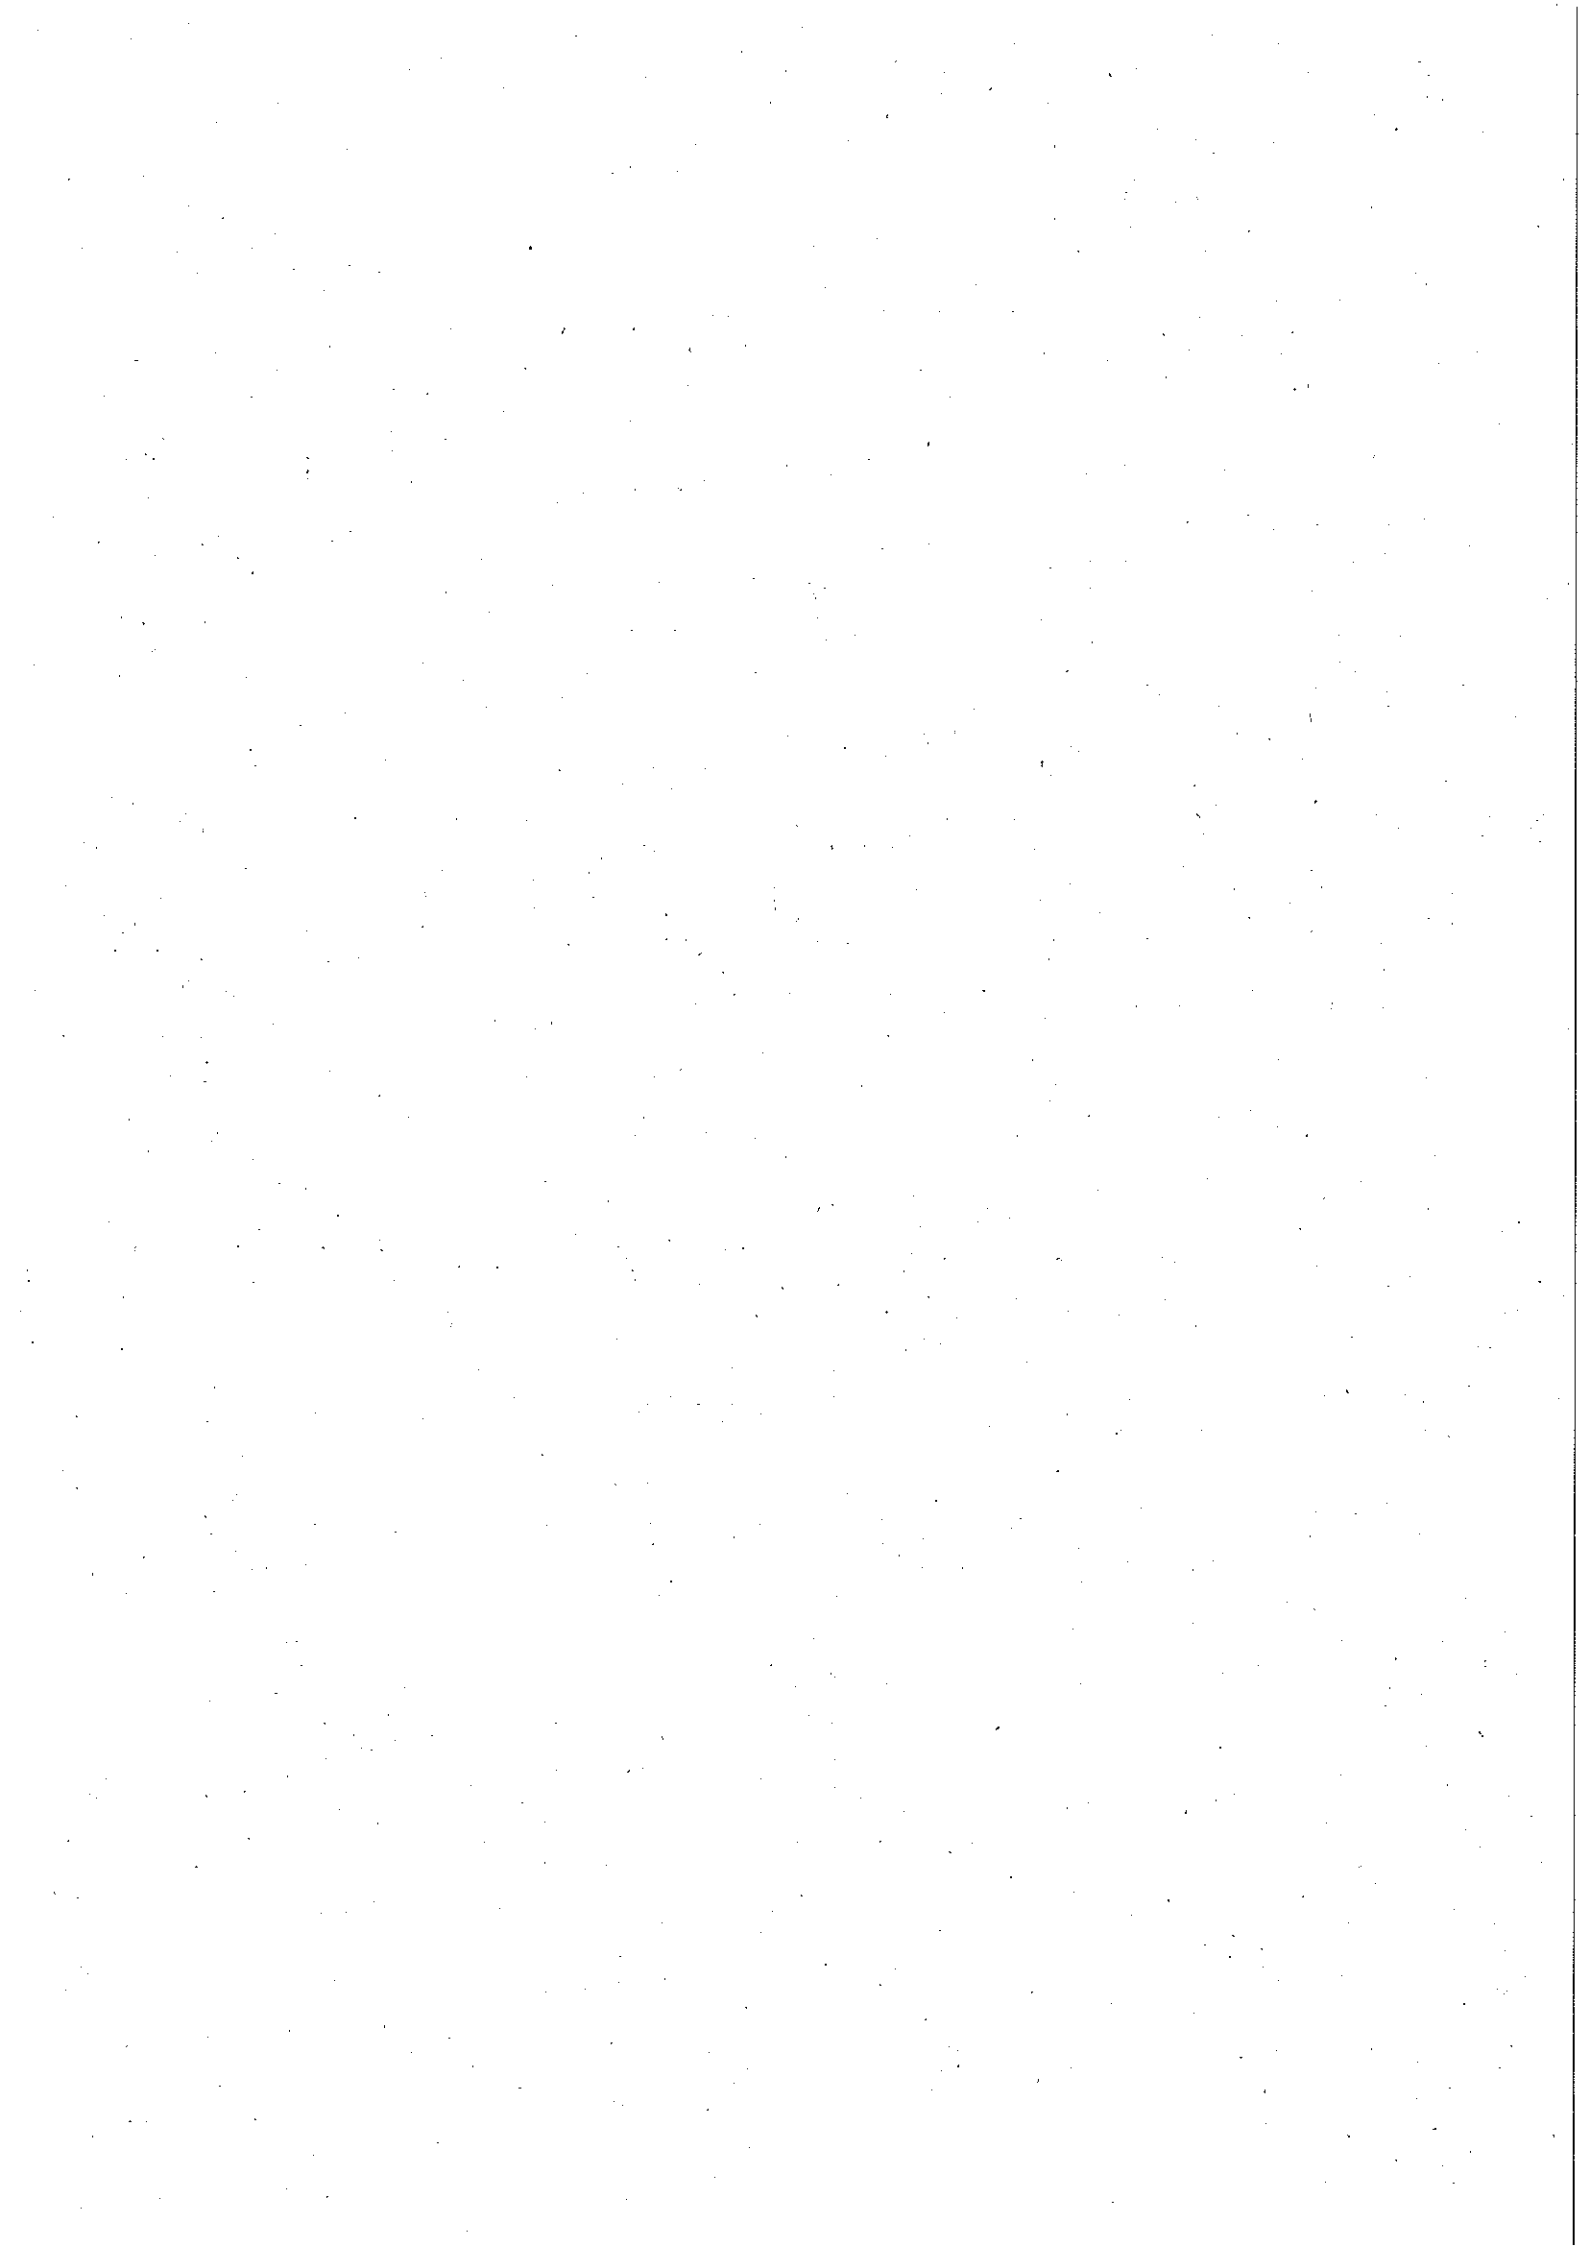

Valoración global efectuada por la Mesa de Contratación de las proposiciones recibidas en el expediente PA/08/2019

ZPIE: 1118001877 Sum. equipos p/ bomba volumétrica de nutrición enteral, líneas de infusión p/ perfusores de jeringa y filtros de 0,2 µm.

Lote 3: Líneas de infusión IV para inyector


Lote	Part.	Material	Descripción	Licitador	Marca	Referencia	Puntuación Sobre 2	Precio Licitación S/VA	Precio Licitador S/VA	1. PRECIO (51,00 PT)	Puntuación Total
3	4	23911	LÍNEA INFUS. IV P/ INYECTOR 150 CM.	BECTON DICKINSON, S.A.	BD	DH-150	49,00	1,07438	0,25	51,00	100,00
3	4	23911	LÍNEA INFUS. IV P/ INYECTOR 150 CM.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	SEDAT	S0163PL	49,00	1,07438	0,96	7,08	56,08
3	5	12048	LÍNEA INFUS. IV P/ INYECTOR 50 CM.	BECTON DICKINSON, S.A.	BD	DH-50	49,00	0,206612	0,19	34,17	83,17

El Secretario




Fdo.: Pedro Anguita Rubio

La Presidenta

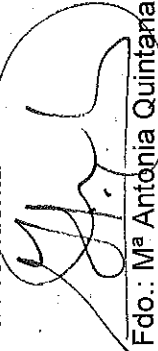

Fdo.: Mª Antonia Quintana Cortijo

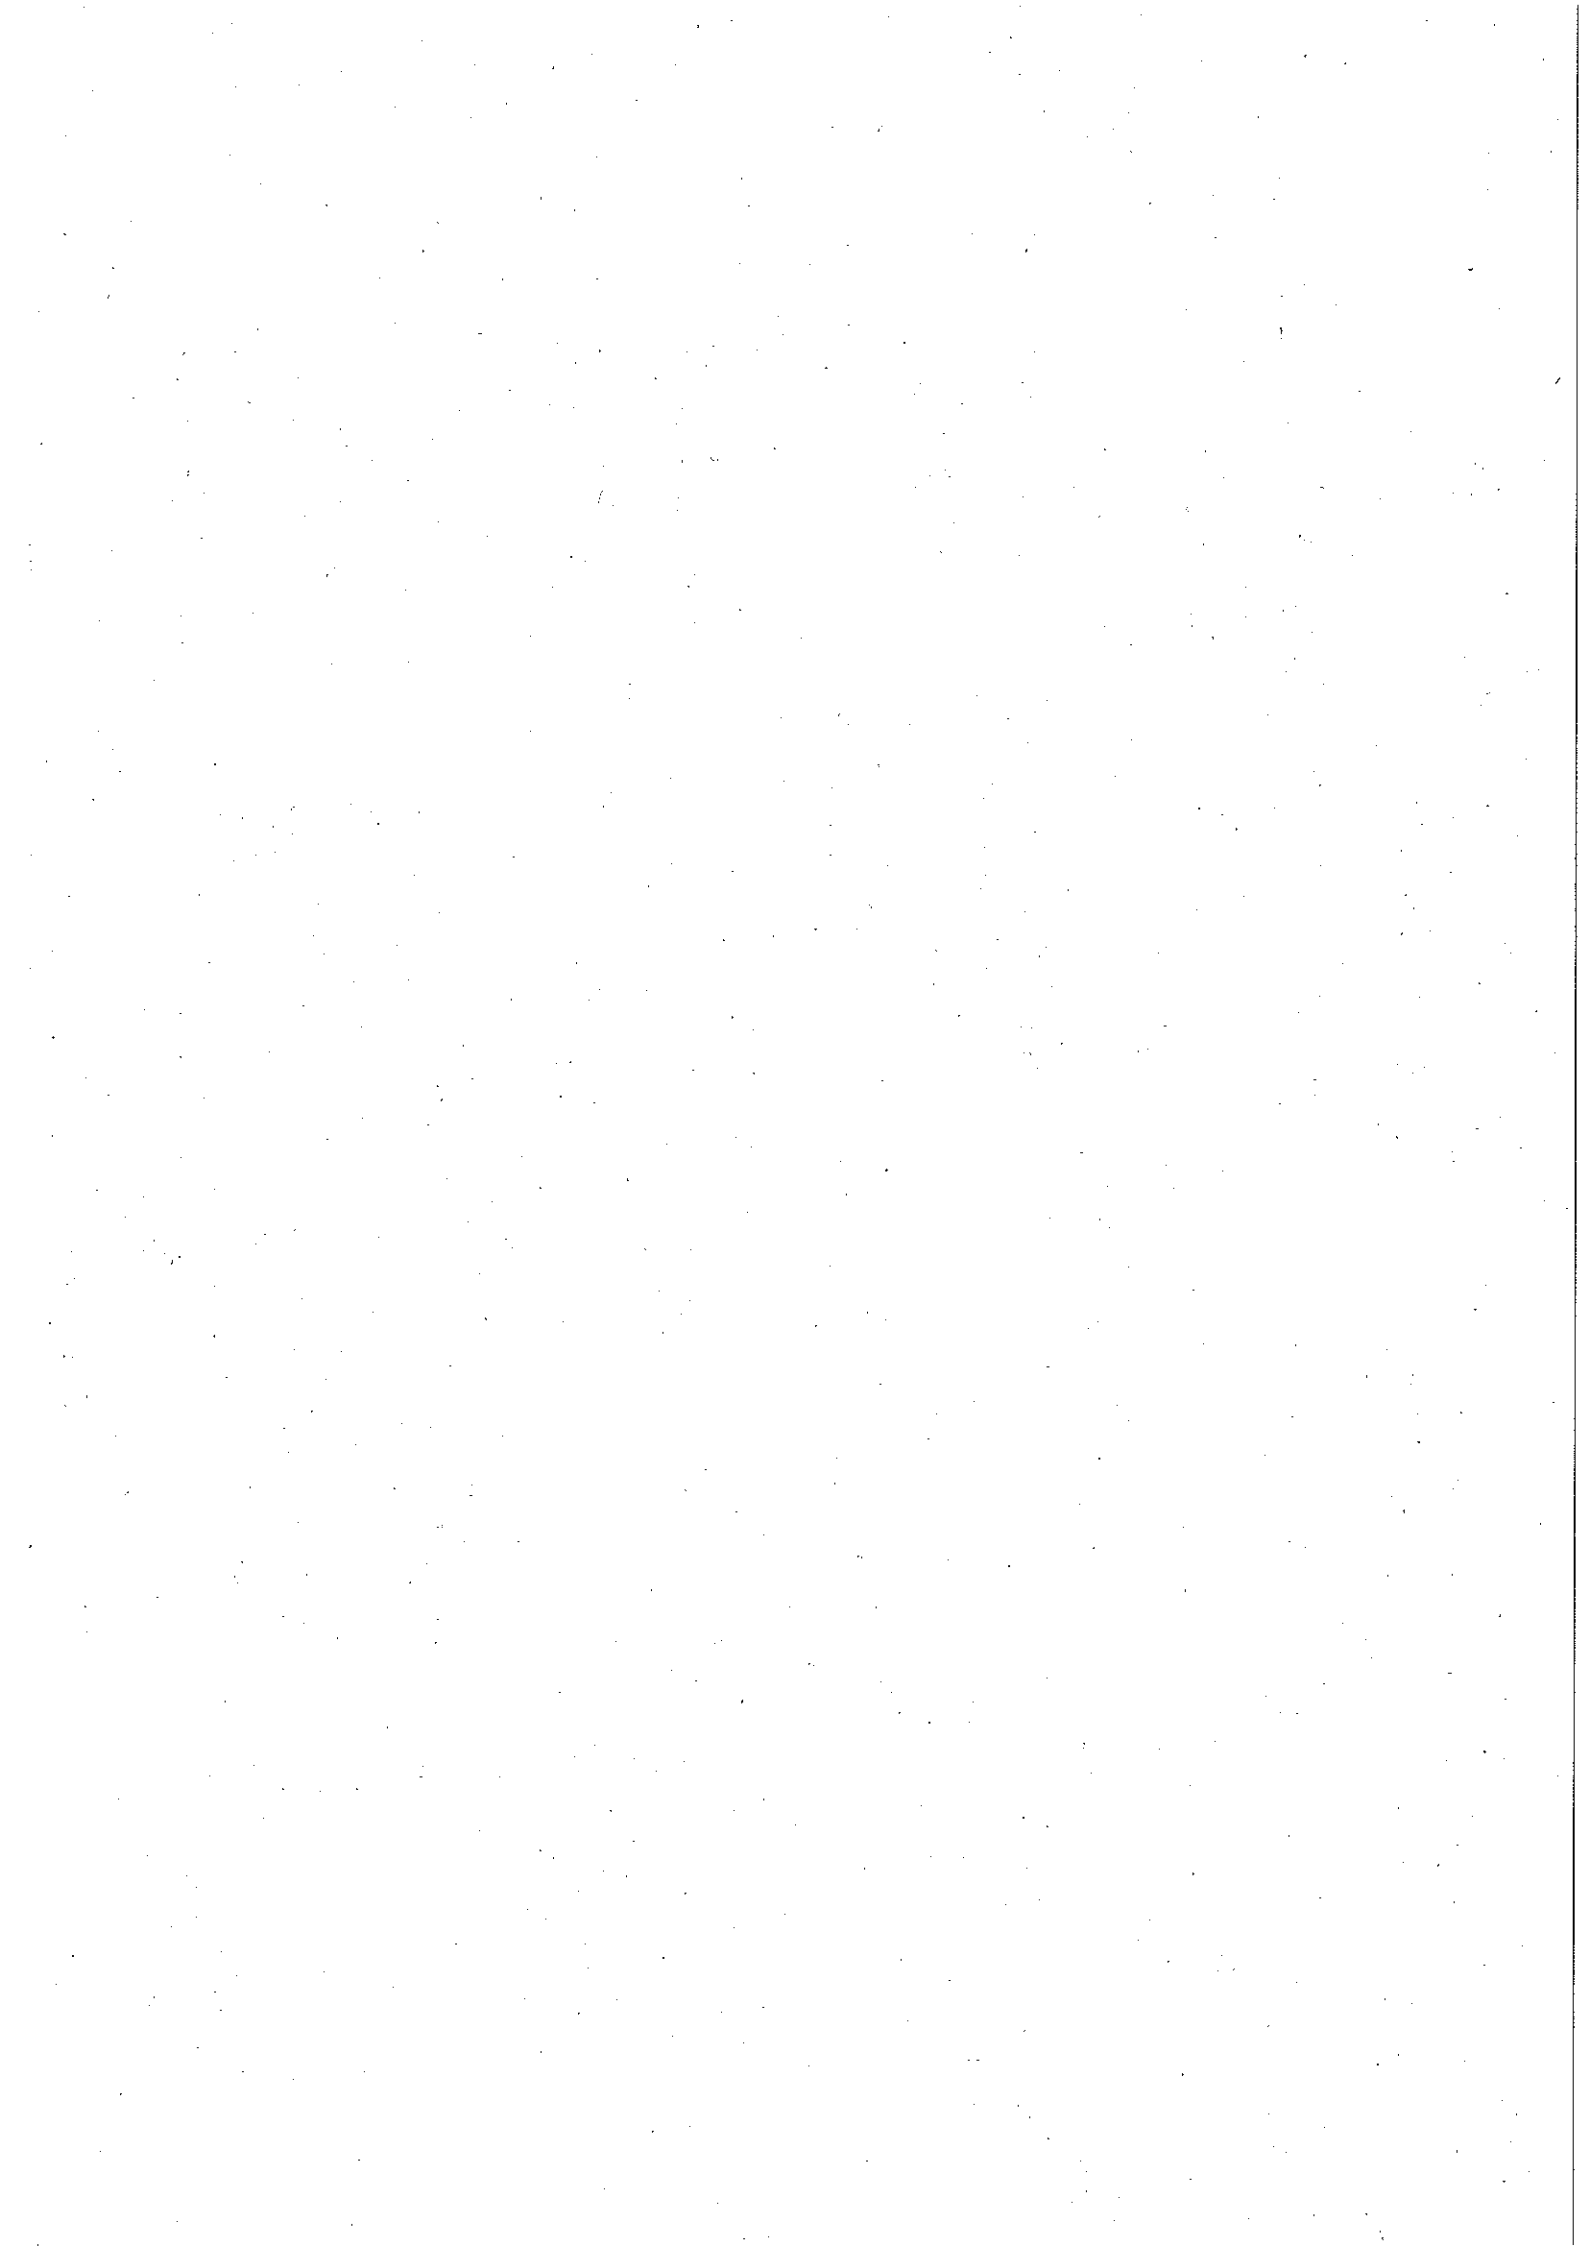

Propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de contratación para el expediente PA/08/2019 "Suministro de equipos para bomba volumétrica de nutrición enteral, líneas de infusión para perfusores de jeringa y filtros de 0,2 µm."

ZPIE: 1118001877

Lote	Partida	Material	Descripción	Referencia	Cantidad		Precio		Importe sin IVA		Importe con IVA		Total			
					2019	2020	Sin IVA	T/IVA	Con IVA	2019	2020	2019		2020		
<b>BECTON DICKINSON S.A. (100003456)</b>																
3	4	23911	LINEA INFUS.IV P/ INYECTOR 150CM	DH-150	3843	2.562	6.405	0,2500	21%	0,3025	960,75	640,50	1.601,25	1.162,51	775,01	1.937,52
3	5	12048	LINEA INFUS.IV P/ INYECTOR 50CM	DH-50	20414	13.609	34.023	0,1900	21%	0,2299	3.878,66	2.585,71	6.464,37	4.693,18	3.128,71	7.821,89
											<b>4.839,41</b>	<b>3.226,21</b>	<b>8.065,62</b>	<b>5.855,69</b>	<b>3.903,72</b>	<b>9.759,41</b>

**FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. (100000169)**


1	1	90004191	EQUIPO NUTRICION ENTERAL C/BOLSA P/BOMBA	7751908	632	421	1.053	3,0000	10%	3,6300	1.896,00	1.263,00	3.159,00	2.294,16	1.528,23	3.822,39
1	2	90004190	EQUIPO NUTRICION ENTERAL POR BOMBA	7751909	29728	19.819	49.547	3,0000	21%	3,6300	89.184,00	59.457,00	148.641,00	98.102,40	65.402,70	163.505,10
											<b>91.080,00</b>	<b>60.720,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>100.396,56</b>	<b>66.930,93</b>	<b>167.327,49</b>

95.919,41	63.946,21	159.865,62	106.252,25	70.834,65	177.086,90
-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------

El Secretario

  
Ede.: Pedro Anguita Rubio

La Presidenta

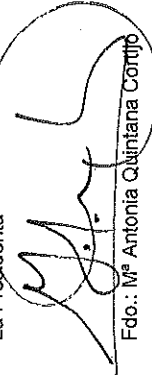  
Fdo.: M<sup>a</sup> Antonia Quintana Conjifo

