

Expediente N.º LICT/99/159/2024/0051

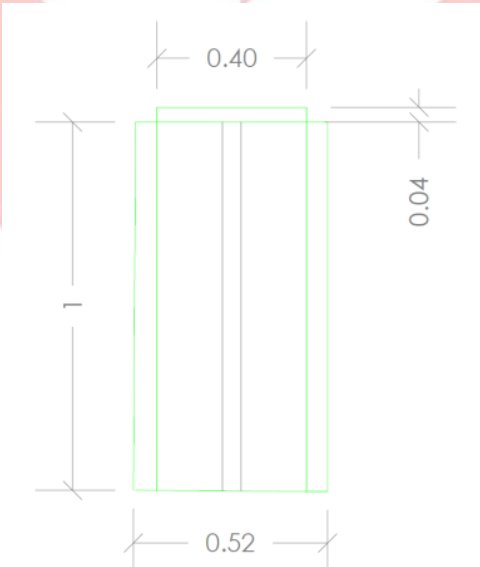
ANEXO C. CRITERIOS DE VALORACIÓN

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

3.- Calidad del equipamiento

Calidad lavadora termodesinfectadora	20 puntos
Optimización del volumen del equipo con el espacio disponible	5 puntos
Se valorará con un máximo de 5 puntos la optimización del volumen del equipo con el espacio disponible. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una optimización mayor del volumen de la lavadora con el espacio disponible. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.	
Facilidad de carga	5 puntos
Se valorará con un máximo de 5 puntos la facilidad de carga. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una facilidad de carga mayor para el personal sanitario. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.	
Facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del equipo	4 puntos
Se valorará con un máximo de 4 puntos la facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del equipo. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo de la lavadora mayor para el personal sanitario. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.	
Funcionalidades antiquemaduras	3 puntos
Se valorará con un máximo de 3 puntos las funcionalidades antiquemaduras. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con funcionalidades antiquemaduras que aporten una protección antiquemaduras mayor. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.	
Menor nivel de ruido (en Decibelios)	3 puntos
Se valorará con un máximo de 3 puntos el nivel de ruido del equipo durante las fases de lavado y durante el secado. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una emisión de ruido en Decibelios durante las fases de lavado y durante el secado menor. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.	

Calidad esterilizador a vapor	20 puntos
Volumen útil en litros de la cámara	6 puntos
Se valorará con un máximo de 6 puntos el volumen útil en litros de la cámara del equipo. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con un mayor volumen útil en litros de la cámara. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.	

Facilidad de carga	6 puntos
Se valorará con un máximo de 6 puntos la facilidad de carga. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una facilidad de carga mayor para el personal sanitario. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.	
Facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del equipo	6 puntos
Se valorará con un máximo de 6 puntos la facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del equipo. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del esterilizador mayor para el personal sanitario. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.	
Compatibilidad del esterilizador con los carros eléctricos de carga que dispone el Hospital actualmente	2 puntos
<p>Se valorará con 2 puntos la compatibilidad en el uso del esterilizador ofertado con los carros eléctricos de carga disponibles en el Centro Hospitalario. Dichos carros cargan los esterilizadores disponibles, que cuentan con una cámara de 670x670x1000 mm. Las medidas exteriores en metros de la base del carro que dispone el Hospital donde se coloca el contenedor (base de carro actual visto desde arriba), son: la parte de acople del carro al equipo de esterilización tiene una anchura de 0,405 m y una profundidad de 0.04 m. La longitud de las guías donde se sitúa el contenedor es de 1 m con una anchura total de 0.52m. En caso de ser compatible, el licitador obtendrá 1 punto. En caso contrario, obtendrá 0 puntos. Se adjunta croquis:</p> 	
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS	PUNTOS (40)